
ticare

MOVING FOR CARE

inHEX

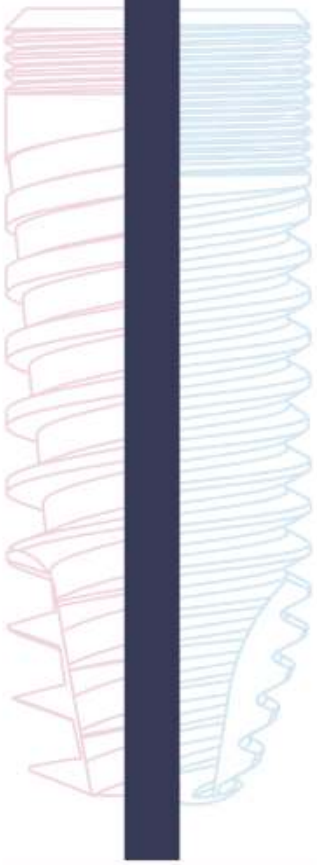

GAP ZERO TECHNOLOGY ticare

ONE



Nuestra historia

Ticare nace como evolución de Mozo Grau, compañía fundada en Valladolid (España) en 1996. Desde nuestros inicios, hemos trabajado con un propósito claro: investigar, diseñar y desarrollar soluciones fiables para la implantología dental, combinando evidencia científica, innovación y experiencia.

La búsqueda de la excelencia forma parte de nuestro trabajo diario. Analizamos cada variable que interviene en el desarrollo de nuestros productos y trasladamos el conocimiento científico a soluciones precisas, fiables y adaptadas a las necesidades de la práctica clínica.

La cualificación y el compromiso de nuestro equipo, junto con la colaboración de profesionales, universidades, sociedades científicas y grupos de investigación, nos permiten seguir evolucionando y afrontar los nuevos retos de la salud periimplantaria.

Tecnología y precisión

La tecnología y la precisión son dos de los pilares de Ticare. Contamos con equipamiento de última generación y procesos de fabricación capaces de alcanzar precisiones de hasta 0,001mm.

Esta capacidad tecnológica, unida a rigurosos sistemas de control, nos permite fabricar componentes con tolerancias extremadamente exigentes y garantizar la precisión y fiabilidad de cada pieza. A ello se suma GapZero®, tecnología exclusiva de Ticare, que permite alcanzar un ajuste preciso entre implante y prótesis.

Invertimos de forma continua en tecnología, procesos y conocimiento para seguir avanzando y ofrecer soluciones que respondan a las exigencias de los profesionales y de la implantología actual.





Nuestros clientes

En Ticare creemos que escuchar al profesional es esencial para seguir evolucionando. Por ello, mantenemos una relación cercana con nuestros clientes y colaboramos activamente con profesionales y referentes de la implantología oral.

Nuestra participación en congresos y encuentros científicos, junto con la organización de cursos y actividades formativas, nos permite compartir conocimiento, conocer de primera mano las necesidades del sector e incorporar esa experiencia al desarrollo y mejora continua de nuestras soluciones implanto protésicas.

Esta cercanía, unida a nuestra experiencia y capacidad tecnológica, nos permite ofrecer soporte y desarrollar soluciones adaptadas a las necesidades de cada paciente y mercado, manteniendo siempre el servicio, la seriedad y el rigor que caracterizan a Ticare.

I+D+i
Colaboración científica

La investigación y la innovación forman parte de nuestra manera de entender la implantología. En Ticare apostamos por generar conocimiento que nos permita desarrollar nuevos productos, mejorar los existentes y avanzar en sus técnicas de aplicación.

Por ello, colaboramos con universidades, grupos de investigación, sociedades científicas y profesionales especializados, creando vínculos que acercan la investigación a la práctica clínica.

Nuestro compromiso va más allá del desarrollo de producto: apoyamos proyectos científicos y actividades de formación que contribuyen al crecimiento de los profesionales, al avance de la implantología dental y a mejorar la salud periimplantaria de los pacientes.



La calidad, fundamento de Ticare: Certificaciones



CERTIFICATE N.
CERTIFICADO N. **1310.2019**

MOZO GRAU, S.A.

C/ SANTIAGO LÓPEZ GONZÁLEZ 7 - 47197 VALLADOLID SPAIN

C/ SANTIAGO LÓPEZ GONZÁLEZ 7 - 47197 VALLADOLID SPAIN

EN ISO 13485:2016/A11:2021

Diseño, desarrollo, fabricación y venta de implantes dentales estériles y aditamentos no estériles. Fabricación y venta de aditamentos hechos a medida no estériles.
Diseño, desarrollo, fabricación y venta de instrumental para uso en odontología
Design, development, manufacturing and sales of sterile dental implants and non-sterile abutments. Manufacturing and sales of non-sterile custom-made abutments. Design, manufacturing, distribution and sales of instruments for use in dentistry

2004-08-23 | 2025-07-21 | 2028-08-22

ISO 13485: 2016



EU QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate no. 236/MDR

by the Manufacturer:

MOZO GRAU SA

47197 VALLADOLID - C/SANTIAGO LOPEZ GONZALEZ 7 (ESP) - Spain

SRN: ES-MF-000009479

for the following devices:

Abutment and peripheric components for dental implantology

Dental implants

Surgical instrument for dental implantology

First issue date: 2025-09-04

Expiry Date: 2030-09-03

IMQ

MARCADO CE

US FOOD AND DRUG ADMINISTRATION

Características del envase

Plataforma MINI
ø 3,3 mm

Plataforma STD
ø 3,75 mm

Plataforma STD
ø 4,25 mm

Plataforma MAXI
ø 5,00 mm





Vial superior

Tornillo de cierre

Tapón

Anillo soporte Titanio

Transportador con tornillo de transportador

Implante

Vial inferior

El etiquetado de producto

	Utilizable hasta la fecha		Un solo uso, no reutilizar
	Fabricante		Fecha fabricación
	No utilizar si el envase está dañado	CE 0051	Marcado CE
Rx only	Precaución	MD	Dispositivo médico
STERILE R	Esterilizado por rayos Gamma. Barrera estéril.	2	No reesterilizar
	Instrucciones de uso	UDI	Código UDI
REF	Referencia	LOT	Lote
#	Número de modelo		



Índice

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

	Presentación	3
	Calidad	4
	Características de envase y etiquetado de producto	5
	Índice	6
	gapZero®	7
IMPLANTES	**Sistema de implantes Inhex TrC**	8
	Implante Inhex V2 TrC MINI 3,30	10
	Implante Inhex V2 TrC STD 3,75	10
	Implante Inhex V2 TrC STD 4,25	11
	Implante Inhex V2 TrC Maxi 5,00	11
	Implante Inhex Quattro TrC MINI 3,30	15
	Implante Inhex Quattro TrC STD 3,75	15
	Implante Inhex Quattro TrC STD 4,25	15
	Protocolo de fresado crestal	16
	Sistema de implantes Inhex híbrido	18
	Implante Inhex V2 híbrido MINI 3,30	19
	Implante Inhex V2 híbrido STD 3,75	19
	Implante Inhex V2 híbrido STD 4,25	20
	Implante Inhex V2 híbrido MAXI 5,00	20
	Implante Inhex Quattro híbrido MINI 3,30	21
	Implante Inhex Quattro híbrido STD 3,75	21
	Implante Inhex Quattro híbrido STD 4,25	21
ticare INSTRUMENTAL QUIRURGICO	**Llaves dinamométricas y destornilladores**	22
ticare BioCAM	**BioCam**	24
	Scanbodies Ticare	25
	Correcciones de angulación	26
	Scanbodies de otras conexiones	27
	Tornillos BioCam y correspondencias	28
ticare inHEX PRÓTESIS	**Sistema de Prótesis Inhex**	31
	Árboles de prótesis	32
	Aditamentos protésicos Inhex	40
	Aditamentos temporales/carga inmediata Inhex	58
	Tornillos para pilares y postes Inhex	60
ticare COMPACT SURGICAL BOX	**Compact Surgical Box y Bandejas**	63
	Fresas para implantes	65
	Instrumental quirúrgico	70
ticare fidelis CIRUGÍA GUIADA	**Flujo digital. Cirugía Guiada Fidelis**	73
	Anexos	77

Edición 27

GAP ZERO®
TECHNOLOGY


ticare

LA TECNOLOGÍA QUE DISMINUYE EL RIESGO DE PERIIMPLANTITIS

El único sistema con evidencia científica de **gapZero®**

ticare
MOVING FOR CARE

EXCELENTE MANTENIMIENTO
del nivel de hueso marginal

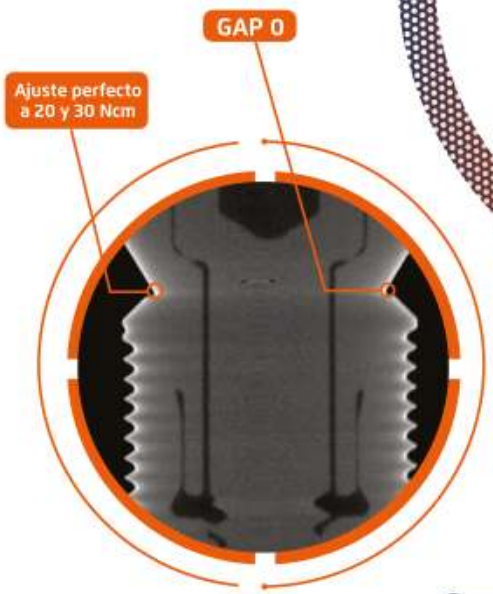



EL IMPLANTE LIBRE DE FILTRACIÓN BACTERIANA

ESTUDIOS Y ENSAYOS CLÍNICOS
con Ticare acreditan el gapZero® y sus beneficios clínicos.



GAP ZERO TECHNOLOGY ticare

Implantes Inhex® TrC

inHEX V2TrC

inHEX quattro TrC

ticare

CONEXIÓN CÓNICA INTERNA
con gapZero®

HOMBRO MAQUINADO
para platform switching y una estética máxima


MICROESPIRAS
para un mejor comportamiento biomecánico

ESPIRA DE DOBLE ROSCA
que reduce a la mitad el tiempo de inserción y el calentamiento óseo

SUPERFICIE RBM-TC
para un mayor contacto hueso-implante

FORMA ANATÓMICA
para una alta estabilidad primaria y facilidad de inserción

ÁPICE MÁS EFICAZ
gracias a un cono más afilado que aporta estabilidad primaria adicional

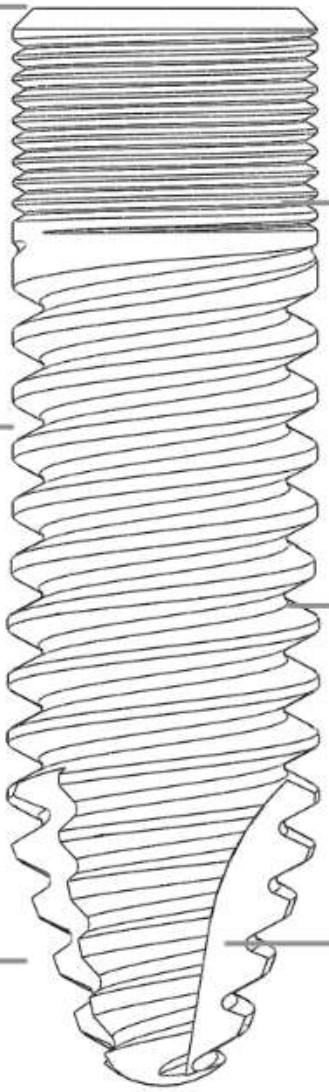

GAP ZERO TECHNOLOGY ticare

inHEX V2TrC



Inhex V2 TrC 3,3 mm MINI

CE 0051 Compliance according to Regulation (EU) 2017/745 verified by Notified Body

REF.	DESCRIPCIÓN
23403310	Implante Inhex V2 TrC MINI 3,3 x 10 mm ONE
23403311	Implante Inhex V2 TrC MINI 3,3 x 11,5 mm ONE
23403313	Implante Inhex V2 TrC MINI 3,3 x 13 mm ONE
23403315	Implante Inhex V2 TrC MINI 3,3 x 15 mm ONE
23203325	Tornillo de cierre Inhex Mini

Transportador milimetrado y con marcado de posición del hexágono del implante



Inhex V2 TrC

- Material Titanio grado V
- Superficie RBM-TC
- Conexión cónica interna de 11°
- Doble hexágono interno
- Microespiras en el cuello del implante
- Diámetro del implante 3,3 mm
- Plataforma del implante: 2,3 mm
- Rosca Interna 1,4 mm
- Tornillo de cierre incluido (torque máximo 10 Ncm)
- Premontado con transportador largo
- Envasado estéril "no touch"
- Codificado con color amarillo

Recomendaciones:
- Zonas anteriores (incisivos laterales superiores e incisivos inferiores)
- Zonas de carga reducida
- Torque máximo de inserción recomendado: 45 Ncm

Inhex V2 TrC 3,75 mm STD

CE 0051 Compliance according to Regulation (EU) 2017/745 verified by Notified Body

REF.	DESCRIPCIÓN
23403708	Implante Inhex V2 TrC STD 3,75 x 8 mm ONE
23403710	Implante Inhex V2 TrC STD 3,75 x 10 mm ONE
23403711	Implante Inhex V2 TrC STD 3,75 x 11,5 mm ONE
23403713	Implante Inhex V2 TrC STD 3,75 x 13 mm ONE
23403715	Implante InhexV2 TrC STD 3,75 x 15 mm ONE
23205001	Tornillo de cierre Inhex STD

Transportador milimetrado y con marcado de posición del hexágono del implante



Inhex V2 TrC

- Material Titanio c.p. de grado IV
- Superficie RBM-TC
- Conexión cónica interna 11°
- Doble hexágono interno
- Microespiras en el cuello del implante
- Diámetro del implante 3,75 mm
- Plataforma del implante 2,8 mm
- Rosca Interna 1,6 mm
- Tornillo de cierre incluido (torque máximo 10 Ncm)
- Premontado con el transportador
- Envasado estéril "no touch"
- Codificado con color azul

Recomendaciones:
- Para todas las posiciones de la boca
- Torque máximo de inserción recomendado: 45 Ncm



Inhex V2 TrC 4,25 mm STD

CE Compliance according to Regulation 0051 (EU) 2017/745 verified by Notified Body

REF.	DESCRIPCIÓN
23404206	Implante Inhex V2 TrC STD 4,25 x 6 mm ONE
23404208	Implante Inhex V2 TrC STD 4,25 x 8 mm ONE
23404210	Implante Inhex V2 TrC STD 4,25 x 10 mm ONE
23404211	Implante Inhex V2 TrC STD 4,25 x 11,5 mm ONE
23404213	Implante Inhex V2 TrC STD 4,25 x 13 mm ONE
23404215	Implante Inhex V2 TrC STD 4,25 x 15 mm ONE
23205001	Tornillo de cierre Inhex STD

Transportador milimetrado y con marcado de posición del hexágono del implante



Inhex V2 TrC

- Material Titanio c.p. grado IV
- Superficie RBM-TC
- Conexión cónica interna de 11°
- Doble hexágono interno
- Microespiras en el cuello del implante
- Diámetro del implante: 4,25 mm
- Plataforma del implante 2,8 mm
- Rosca Interna 1,6 mm
- Tornillo de cierre incluido (torque máximo 10 Ncm)
- Premontado con el transportador
- Envasado estéril "no touch"
- Codificado con color lila

Recomendaciones:
- Para todas las posiciones de la boca
- Torque máximo de inserción recomendado: 45 Ncm

Inhex V2 TrC 5 mm STD

CE Compliance according to Regulation 0051 (EU) 2017/745 verified by Notified Body

REF.	DESCRIPCIÓN
23405406	Implante Inhex V2 TrC STD 5 x 6 mm ONE
23205001	Tornillo de cierre Inhex STD

Transportador milimetrado y con marcado de posición del hexágono del implante



Inhex V2 TrC

- Material Titanio c.p. grado IV
- Superficie RBM-TC
- Conexión cónica interna de 11°
- Doble hexágono interno
- Microespiras en el cuello del implante
- Diámetro del implante: 5 mm
- Plataforma del implante 2,8 mm
- Rosca Interna 1,6 mm
- Tornillo de cierre incluido (torque máximo 10 Ncm)
- Premontado con el transportador
- Envasado estéril "no touch"
- Codificado con color turquesa
- Conexión STD - Utilizar componentes de plataforma STD

Recomendaciones:
- Para sector posterior con poca disponibilidad ósea siempre que exista suficiente espacio
- Torque máximo de inserción recomendado: 45 Ncm

Inhex V2 TrC 5 mm MAXI

CE Compliance according to Regulation 0051 (EU) 2017/745 verified by Notified Body

REF.	DESCRIPCIÓN
23405009	Implante Inhex V2 TrC MAXI 5 x 9 mm ONE
23405010	Implante Inhex V2 TrC MAXI 5 x 10 mm ONE
23405011	Implante Inhex V2 TrC MAXI 5 x 11,5 mm ONE
23405013	Implante Inhex V2 TrC MAXI 5 x 13 mm ONE
23405015	Implante Inhex V2 TrC MAXI 5 x 15 mm ONE
23205000	Tornillo de cierre Inhex MAXI

Transportador milimetrado y con marcado de posición del hexágono del implante



Inhex V2 TrC

- Material Titanio c.p. grado IV
- Superficie RBM-TC
- Conexión cónica interna de 11 °
- Doble hexágono interno
- Microespiras en el cuello del implante
- Diámetro del implante: 5 mm
- Plataforma del implante 3,8 mm
- Rosca Interna 2,0 mm
- Tornillo de cierre incluido (torque máximo 10 Ncm)
- Premontado con el transportador
- Envasado estéril "no touch"
- Codificado con color turquesa

Recomendaciones:
- Para todas las posiciones de la boca siempre que exista suficiente espacio
- Torque máximo de inserción recomendado: 45 Ncm

inHEX V2TrC

EL IMPLANTE LIBRE DE FILTRACIÓN BACTERIANA

GAP ZERO TECHNOLOGY ticare



HOMBRO MAQUINADO
para platform switching
y una estética máxima

MICROESPIRAS
para un mejor comportamiento
biomecánico

ESPIRA DOBLE ROSCA
que reduce a la mitad
el tiempo de inserción
y el calentamiento óseo

SUPERFICIE RBM-TC
para un mayor contacto
hueso-implante

FORMA ANATÓMICA
para una alta estabilidad
primaria y facilidad de
inserción

ÁPICE MÁS EFICAZ
gracias a un cono más apuntado
que aporta estabilidad primaria
adicional



IMPLANTE
CORTO
inHEX
LA GRAN SOLUCIÓN

EXCELENTE MANTENIMIENTO
del nivel de hueso marginal


El único sistema con evidencia científica de **gapZero®**

ticare

CONEXIÓN GAPZERO®

HOMBRO MAQUINADO
para platform switching
y una estética máxima

MICROESPIRAS
para un mejor
comportamiento
biomecánico

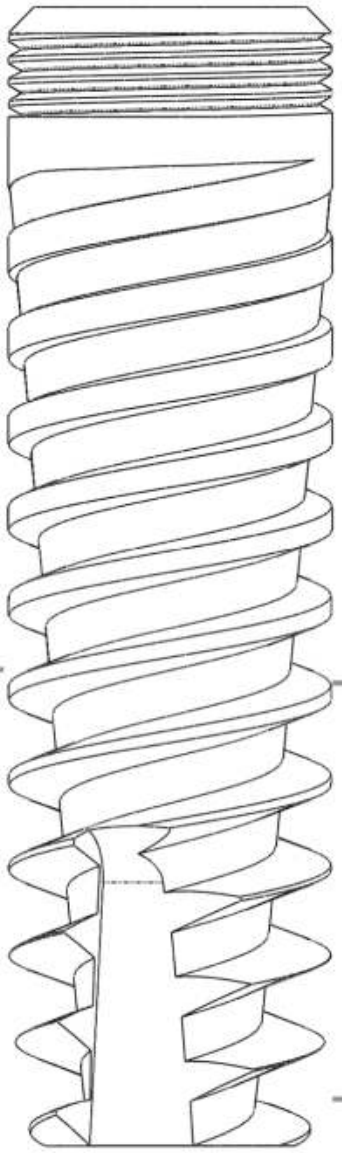

Diseño de rosca
que ofrece máxima
estabilidad en
HUESO POCO DENSO

SUPERFICIE RBM-TC
para un mayor contacto
hueso-implante

FORMA PLANA
para geometría
de corte eficaz

GAP ZERO TECHNOLOGY ticare

inHEX quattro

TrC

inHEX quattro TrC

MÁS SOLUCIONES PARA EL HUESO BLANDO

GAP ZERO TECHNOLOGY ticare



ESTABILIDAD PRIMARIA
Especialmente diseñado para hueso III y IV

MAYOR PROGRESIVIDAD
en el torque de inserción

Diseño de rosca que ofrece máxima estabilidad en **HUESO POCO DENSO**

FORMA PLANA
para geometría de corte eficaz

MEJOR COMPORTAMIENTO EN POST EXTRACCIÓN

PREDICTIBILIDAD
El implante libre de filtración bacteriana con resultados probados clínica y científicamente



Inhex Quattro TrC 3,3 mm MINI

CE 0051 Compliance according to Regulation (EU) 2017/745 verified by Notified Body

REF.	DESCRIPCIÓN
25403310	Implante Inhex Quattro TrC MINI 3,3 x 10 mm ONE
25403311	Implante Inhex Quattro TrC MINI 3,3 x 11,5 mm ONE
25403313	Implante Inhex Quattro TrC MINI 3,3 x 13 mm ONE
25403315	Implante Inhex Quattro TrC MINI 3,3 x 15 mm ONE
23203325	Tornillo de cierre Inhex MINI

Transportador milimetrado y con marcado de posición del hexágono del implante



Inhex Quattro TrC

- Material Titanio grado V
- Superficie RBM-TC
- Conexión cónica interna de 11°
- Doble hexágono interno
- Microespiras en el cuello del implante
- Diámetro del implante: 3,3 mm
- Plataforma del implante 2,3 mm
- Rosca interna 1,4 mm
- Tornillo de cierre incluido (torque máximo 10 Ncm)
- Premontado con transportador largo
- Envasado estéril "no touch"
- Codificado en color amarillo

Recomendaciones:
- Incisivos laterales superiores
- Zonas de carga reducida
- Hueso tipo III y IV
- Alveolos postextracción
- Contraindicado para hueso tipo I
- Torque máximo de inserción recomendado: 45 Ncm

Inhex Quattro TrC 3,75 mm STD

CE 0051 Compliance according to Regulation (EU) 2017/745 verified by Notified Body

REF.	DESCRIPCIÓN
25403708	Implante Inhex Quattro TrC STD 3,75 x 8 mm ONE
25403710	Implante Inhex Quattro TrC STD 3,75 x 10 mm ONE
25403711	Implante Inhex Quattro TrC STD 3,75 x 11,5 mm ONE
25403713	Implante Inhex Quattro TrC STD 3,75 x 13 mm ONE
25403715	Implante Inhex Quattro TrC STD 3,75 x 15 mm ONE
23205001	Tornillo de cierre Inhex STD

Transportador milimetrado y con marcado de posición del hexágono del implante



Inhex Quattro TrC

- Material Titanio c.p. grado IV
- Superficie RBM-TC
- Conexión cónica interna de 11°
- Doble hexágono interno
- Microespiras en el cuello del implante
- Diámetro del implante: 3,75 mm
- Plataforma del implante 2,8 mm
- Rosca Interna 1,6 mm
- Tornillo de cierre incluido (torque máximo 10 Ncm)
- Premontado con el transportador
- Envasado estéril "no touch"
- Codificado con color azul

Recomendaciones:
- Maxilar superior
- Hueso tipo III y IV
- Alveolos postextracción
- Contraindicado para hueso tipo I
- Torque máximo de inserción recomendado: 45 Ncm

Inhex Quattro TrC 4,25 mm STD

CE 0051 Compliance according to Regulation (EU) 2017/745 verified by Notified Body

REF.	DESCRIPCIÓN
25404208	Implante Inhex Quattro TrC STD 4,25 x 8 mm ONE
25404210	Implante Inhex Quattro TrC STD 4,25 x 10 mm ONE
25404211	Implante Inhex Quattro TrC STD 4,25 x 11,5 mm ONE
25404213	Implante Inhex Quattro TrC STD 4,25 x 13 mm ONE
25404215	Implante Inhex Quattro TrC STD 4,25 x 15 mm ONE
23205001	Tornillo de cierre Inhex STD

Transportador milimetrado y con marcado de posición del hexágono del implante



Inhex Quattro TrC

- Material Titanio c.p. grado IV
- Superficie RBM-TC
- Conexión cónica interna de 11°
- Doble hexágono interno
- Microespiras en el cuello del implante
- Diámetro del implante: 4,25 mm
- Plataforma del implante: 2,8 mm
- Rosca Interna 1,6 mm
- Tornillo de cierre incluido (torque máximo 10 Ncm)
- Premontado con el transportador
- Envasado estéril "no touch"
- Codificado con color lila

Recomendaciones:
- Maxilar superior
- Hueso tipo III y IV
- Alveolos postextracción
- Contraindicado para hueso tipo I
- Torque máximo de inserción recomendado: 45 Ncm

Protocolo de fresado crestal

inHEX V2TrC

inHEX V2 Perio HYBRID



Aplicación secuencia fresado

SECUENCIA ESTÁNDAR



SECUENCIA HUESOS DUROS




No utilizar la fresa perfiladora en implantes de 6 mm de longitud

inHEX quattro TrC


inHEX quattro Perio HYBRID

SECUENCIA ESTÁNDAR HUESOS TIPO III Y IV

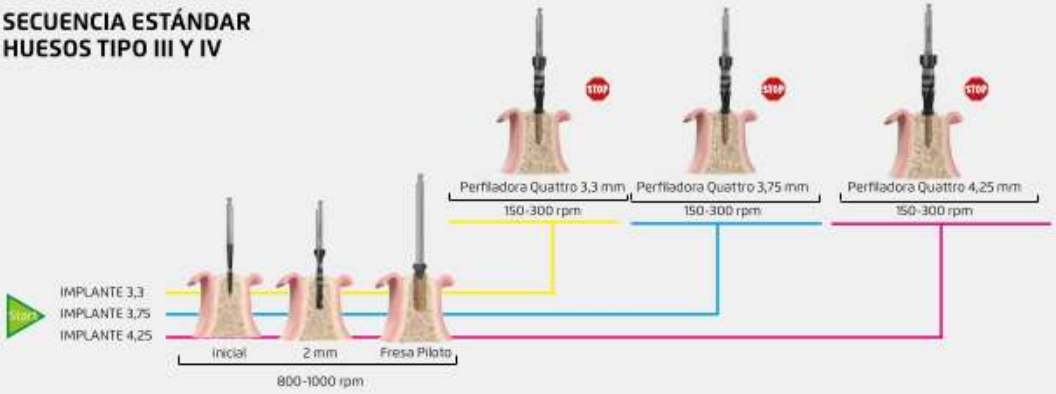



SECUENCIA HUESOS TIPO II

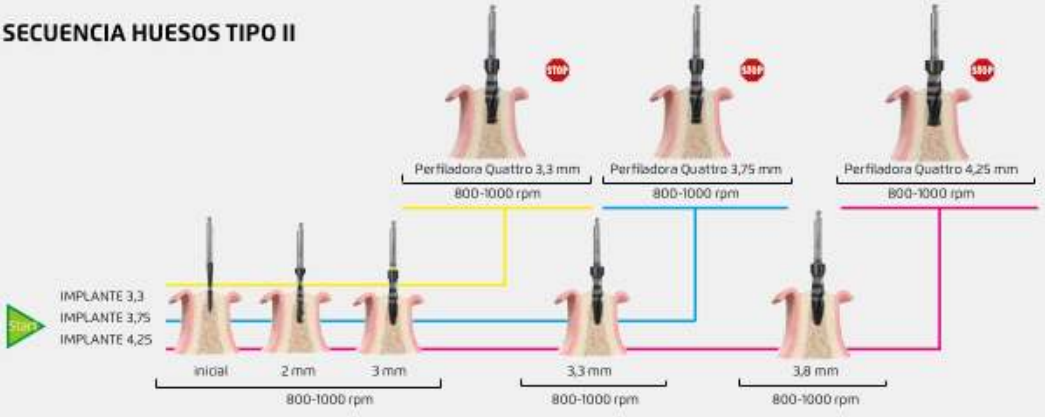

Solo para huesos tipo III y IV la perfiladora Quattro debe introducirse a un máximo de 2 mm de profundidad

Implantes Quattro no recomendados para huesos tipo I

inHEX V2 Perio HYBRID

EL IMPLANTE PARA EL PACIENTE DE RIESGO



GAP ZERO TECHNOLOGY ticare

CONEXIÓN CÓNICA INTERNA
con gapZero

1,5 mm de *ultrabaja* rugosidad
(0,18 µm)

Rugosidad moderada
(1,43 µm)

CON IMPORTATES BENEFICIOS PARA EL PACIENTE

- Cero remodelación ósea
- Mejor predictibilidad ante situaciones adversas

INDICACIONES DE TICARE PERIO HYBRID

Pacientes susceptibles de perder hueso

- Historia de periodontitis o periimplantitis
- Falta de regularidad en terapia de mantenimiento
- Fumadores
- Fenotipo fino de hueso
- Mínima presencia de mucosa queratinizada



inHEX V2 Perio HYBRID

inHEX quattro Perio HYBRID



Misma geometría y conexión que **ticare inhex y ticare inhex quattro,** con los que comparten todos los aditamentos.

Disponibles en las plataformas MINI, STD, MAXI en todas las medidas.



GAP ZERO TECHNOLOGY ticare

Implantes Inhex® híbrido

inHEX V2 Perio HYBRID

inHEX quattro Perio HYBRID




Inhex V2 híbrido 3,3 mm MINI

CE 0051 Compliance according to Regulation (EU) 2017/745 verified by Notified Body

REF.	DESCRIPCIÓN
23623310	Implante Inhex V2 híbrido MINI 3,3 x 10 mm ONE
23623311	Implante Inhex V2 híbrido MINI 3,3 x 11,5 mm ONE
23623313	Implante Inhex V2 híbrido MINI 3,3 x 13 mm ONE
23623315	Implante Inhex V2 híbrido MINI 3,3 x 15 mm ONE
23203325	Tornillo de cierre Inhex MINI

Transportador milimetrado y con marcado de posición del hexágono del implante

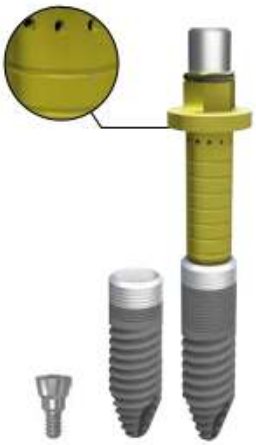

Inhex V2 híbrido

- Material Titanio grado V
- Superficie RBM-TC tratada hasta 1,5 mm antes de la zona coronal
- Conexión cónica interna de 11°
- Doble hexágono interno
- Microespiras en el cuello del implante
- Diámetro del implante 3,3 mm
- Plataforma del implante: 2,3 mm
- Rosca interna 1,4 mm
- Tornillo de cierre incluido (torque máximo 10 Ncm)
- Premontado con transportador largo
- Envasado estéril "no touch"
- Codificado en color amarillo

Recomendaciones:
- Zonas anteriores (incisivos laterales superiores e incisivos inferiores)
- Zonas de carga reducida
- Torque máximo de inserción recomendado: 45 Ncm

Inhex V2 híbrido 3,75 mm STD

CE 0051 Compliance according to Regulation (EU) 2017/745 verified by Notified Body

REF.	DESCRIPCIÓN
23623708	Implante Inhex V2 híbrido STD 3,75 x 8 mm ONE
23623710	Implante Inhex V2 híbrido STD 3,75 x 10 mm ONE
23623711	Implante Inhex V2 híbrido STD 3,75 x 11,5 mm ONE
23623713	Implante Inhex V2 híbrido STD 3,75 x 13 mm ONE
23623715	Implante Inhex V2 híbrido STD 3,75 x 15 mm ONE
23205001	Tornillo de cierre Inhex STD

Transportador milimetrado y con marcado de posición del hexágono del implante



Inhex V2 híbrido

- Material Titanio grado IV
- Superficie RBM-TC tratada hasta 1,5 mm antes de la zona coronal
- Conexión cónica interna de 11°
- Doble hexágono interno
- Microespiras en el cuello del implante
- Diámetro del implante 3,75 mm
- Plataforma del implante: 2,8 mm
- Rosca interna 1,6 mm
- Tornillo de cierre incluido (torque máximo 10 Ncm)
- Premontado con transportador
- Envasado estéril "no touch"
- Codificado en color azul

Recomendaciones:
- Para todas las posiciones de la boca
- Torque máximo de inserción recomendado: 45 Ncm



Inhex V2 híbrido 4,25 mm STD

CE 0051 Compliance according to Regulation (EU) 2017/745 verified by Notified Body

REF.	DESCRIPCIÓN
23624206	Implante Inhex V2 híbrido STD 4,25 x 6 mm ONE
23624208	Implante Inhex V2 híbrido STD 4,25 x 8 mm ONE
23624210	Implante Inhex V2 híbrido STD 4,25 x 10 mm ONE
23624211	Implante Inhex V2 híbrido STD 4,25 x 11,5 mm ONE
23624213	Implante Inhex V2 híbrido STD 4,25 x 13 mm ONE
23624215	Implante Inhex V2 híbrido STD 4,25 x 15 mm ONE
23205001	Tornillo de cierre Inhex STD

Transportador milimetrado y con marcado de posición del hexágono del implante



Inhex V2 híbrido

- Material Titanio grado IV
- Superficie RBM-TC tratada hasta 1,5 mm antes de la zona coronal
- Conexión cónica interna de 11°
- Doble hexágono interno
- Microespiras en el cuello del implante
- Diámetro del implante 4,25 mm
- Plataforma del implante: 2,8 mm
- Rosca interna 1,6 mm
- Tornillo de cierre incluido (torque máximo 10 Ncm)
- Premontado con transportador
- Envasado estéril "no touch"
- Codificado en color púrpura

Recomendaciones:
- Para todas las posiciones de la boca
- Torque máximo de inserción recomendado: 45 Ncm

Inhex V2 híbrido 5 mm STD

CE 0051 Compliance according to Regulation (EU) 2017/745 verified by Notified Body

REF.	DESCRIPCIÓN
23625406	Implante Inhex V2 híbrido STD 5 x 6 mm ONE
23205001	Tornillo de cierre Inhex STD

Transportador milimetrado y con marcado de posición del hexágono del implante



Inhex V2 híbrido

- Material Titanio c.p. grado IV
- Superficie RBM-TC tratada hasta 1,5 mm antes de la zona coronal
- Conexión cónica interna de 11°
- Doble hexágono interno
- Microespiras en el cuello del implante
- Diámetro del implante: 5 mm
- Plataforma del implante 2,8 mm
- Rosca Interna 1,6 mm
- Tornillo de cierre incluido (torque máximo 10 Ncm)
- Premontado con el transportador
- Envasado estéril "no touch"
- Codificado con color turquesa
- Conexión STD - Utilizar componentes de plataforma STD

Recomendaciones:
- Para sector posterior con poca disponibilidad ósea siempre que exista suficiente espacio
- Torque máximo de inserción recomendado: 45 Ncm

Inhex V2 híbrido 5 mm MAXI

CE 0051 Compliance according to Regulation (EU) 2017/745 verified by Notified Body

REF.	DESCRIPCIÓN
23625009	Implante Inhex V2 híbrido MAXI 5 x 9 mm ONE
23625010	Implante Inhex V2 híbrido MAXI 5 x 10 mm ONE
23625011	Implante Inhex V2 híbrido MAXI 5 x 11,5 mm ONE
23625013	Implante Inhex V2 híbrido MAXI 5 x 13 mm ONE
23625015	Implante Inhex V2 híbrido MAXI 5 x 15 mm ONE
23205000	Tornillo de cierre Inhex MAXI

Transportador milimetrado y con marcado de posición del hexágono del implante



Inhex V2 híbrido

- Material Titanio grado IV
- Superficie RBM-TC tratada hasta 1,5 mm antes de la zona coronal
- Conexión cónica interna de 11°
- Doble hexágono interno
- Microespiras en el cuello del implante
- Diámetro del implante 5 mm
- Plataforma del implante: 3,8 mm
- Rosca interna 2,0 mm
- Tornillo de cierre incluido (torque máximo 10 Ncm)
- Premontado con transportador
- Envasado estéril "no touch"
- Codificado en color turquesa

Recomendaciones:
- Para todas las posiciones de la boca siempre que exista suficiente espacio
- Torque máximo de inserción recomendado: 45 Ncm



Inhex Quattro híbrido 3,3 mm MINI

CE 0051 Compliance according to Regulation (EU) 2017/745 verified by Notified Body

REF.	DESCRIPCIÓN
25623310	Implante Inh Quattro híbrido MINI 3,3 x 10 mm ONE
25623311	Implante Inh Quattro híbrido MINI 3,3 x 11,5 mm ONE
25623313	Implante Inh Quattro híbrido MINI 3,3 x 13 mm ONE
25623315	Implante Inh Quattro híbrido MINI 3,3 x 15 mm ONE
23203325	Tornillo de cierre Inhex MINI

Transportador milimetrado y con marcado de posición del hexágono del implante



Inhex Quattro híbrido 3,75 mm STD

CE 0051 Compliance according to Regulation (EU) 2017/745 verified by Notified Body

REF.	DESCRIPCIÓN
25623708	Implante Inh Quattro híbrido STD 3,75 x 8 mm ONE
25623710	Implante Inh Quattro híbrido STD 3,75 x 10 mm ONE
25623711	Implante Inh Quattro híbrido STD 3,75 x 11,5 mm ONE
25623713	Implante Inh Quattro híbrido STD 3,75 x 13 mm ONE
25623715	Implante Inh Quattro híbrido STD 3,75 x 15 mm ONE
23205001	Tornillo de cierre Inhex STD

Transportador milimetrado y con marcado de posición del hexágono del implante



Inhex Quattro híbrido 4,25 mm STD

CE 0051 Compliance according to Regulation (EU) 2017/745 verified by Notified Body

REF.	DESCRIPCIÓN
25624208	Implante Inh Quattro híbrido STD 4,25 x 8 mm ONE
25624210	Implante Inh Quattro híbrido STD 4,25 x 10 mm ONE
25624211	Implante Inh Quattro híbrido STD 4,25 x 11,5 mm ONE
25624213	Implante Inh Quattro híbrido STD 4,25 x 13 mm ONE
25624215	Implante Inh Quattro híbrido STD 4,25 x 15 mm ONE
23205001	Tornillo de cierre Inhex STD



Inhex Quattro híbrido

- Material Titanio grado V
- Superficie RBM-TC tratada hasta 1,5 mm antes de la zona coronal
- Conexión cónica interna de 11°
- Doble hexágono interno
- Microespiras en el cuello del implante
- Diámetro del implante: 3,3 mm
- Plataforma del implante 2,3 mm
- Rosca interna 1,4 mm
- Tornillo de cierre incluido (torque máximo 10 Ncm)
- Premontado con transportador largo
- Envasado estéril "no touch"
- Codificado en color amarillo

Recomendaciones:
- Incisivos laterales superiores
- Zonas de carga reducida
- Hueso tipo III y IV
- Alveolos postextracción
- Contraindicado para hueso tipo I
- Torque máximo de inserción recomendado: 45 Ncm

Inhex Quattro híbrido

- Material Titanio grado IV
- Superficie RBM-TC tratada hasta 1,5 mm antes de la zona coronal
- Conexión cónica interna de 11°
- Doble hexágono interno
- Microespiras en el cuello del implante
- Diámetro del implante: 3,75 mm
- Plataforma del implante 2,8 mm
- Rosca interna 1,6 mm
- Tornillo de cierre incluido (torque máximo 10 Ncm)
- Premontado con transportador
- Envasado estéril "no touch"
- Codificado en color azul

Recomendaciones:
- Maxilar superior
- Hueso tipo III y IV
- Alveolos postextracción
- Contraindicado para hueso tipo I
- Torque máximo de inserción recomendado: 45 Ncm

Inhex Quattro híbrido

- Material Titanio grado IV
- Superficie RBM-TC tratada hasta 1,5 mm antes de la zona coronal
- Conexión cónica interna de 11°
- Doble hexágono interno
- Microespiras en el cuello del implante
- Diámetro del implante: 4,25 mm
- Plataforma del implante 2,8 mm
- Rosca interna 1,6 mm
- Tornillo de cierre incluido (torque máximo 10 Ncm)
- Premontado con transportador
- Envasado estéril "no touch"
- Codificado en color púrpura

Recomendaciones:
- Maxilar superior
- Hueso tipo III y IV
- Alveolos postextracción
- Contraindicado para hueso tipo I
- Torque máximo de inserción recomendado: 45 Ncm









Llaves dinamométricas y destornilladores

ticare
INSTRUMENTAL
QUIRURGICO



Llaves dinamométricas

REF.	DESCRIPCIÓN	
14658040	Llave dinamométrica Torque ajustable entre 10 y 40 Ncm	

Destornilladores de cirugía

CE Compliance according to Regulation (EU) 2017/745

REF.	DESCRIPCIÓN	
15251125	Destornillador carraca 7 mm. dia. hex. 1,25 l. 9 mm	
15252125	Destornillador carraca 7 mm. dia. hex. 1,25 l. 14 mm	
15252525	Destornillador carraca 7 mm. dia. hex. 1,25 l. 25 mm	
15253125	Destornillador carraca 7 mm. dia. plano l. 14 mm	

Destornilladores de prótesis

CE Compliance according to Regulation (EU) 2017/745

REF.	DESCRIPCIÓN	
15261125	Destornillador torque hexagonal carraca corto l. 9 mm	
15262125	Destornillador torque hexagonal carraca largo l. 14 mm	

Puntas

CE Compliance according to Regulation (EU) 2017/745

REF.	DESCRIPCIÓN	
13801525	Destornillador para c/a hex. corto 1,25 l. 9 mm	
13802525	Destornillador para c/a hex. largo 1,25 l. 14 mm	
13803125	Destornillador para c/a plano l. 14 mm	
13861125	Destornillador torque para c/a hex. l. 9 mm	
13862125	Destornillador torque para c/a hex. l. 14 mm	
19008393	Locator® herramienta Core Tool	

Mango

CE Compliance according to Regulation (EU) 2017/745

REF.	DESCRIPCIÓN	
21000600	Mango destornillador extraoral	

LLAVES DINAMOMÉTRICAS

- Las llaves dinamométricas aseguran que los tornillos de prótesis estén apretados con precisión al torque recomendado
- Gran comodidad de trabajo en la zona posterior
- Producto de distribución

DESTORNILLADORES DE CIRUGÍA

- Utilizar el destornillador hexagonal 1,25 mm para los tornillos de cierre y de cicatrización y para todos los tornillos de prótesis, a excepción de cuando se usen tornillos de ranura y correcciones de angulación con BioCam.

DESTORNILLADORES DE PRÓTESIS

- La superficie de contacto dentro del hexágono del tornillo es máxima.
- Recomendado para el torque final de restauraciones.

PUNTAS

- Utilizar las puntas de contra-ángulo junto con el contra-ángulo convencional con control de torque.
- Opción con multiconversor Ref:18089021

-Utilizar la Locator® Core Tool para colocar y retirar pilares Over-Loc y elementos retentivos Locator®. El Locator® Core Tool es un producto de distribución.


MANGO

- Utilizar con los destornilladores con conexi,on C/A
- Utilizar en situaciones comprometidas, en posteriores con difícil acceso (toma de impresiones)
- No recomendado para la inserción del implante

ticare FlujoDIGITAL

CERRANDO EL CÍRCULO PARA UN AJUSTE PERFECTO

ESCANEADO INTRAORAL

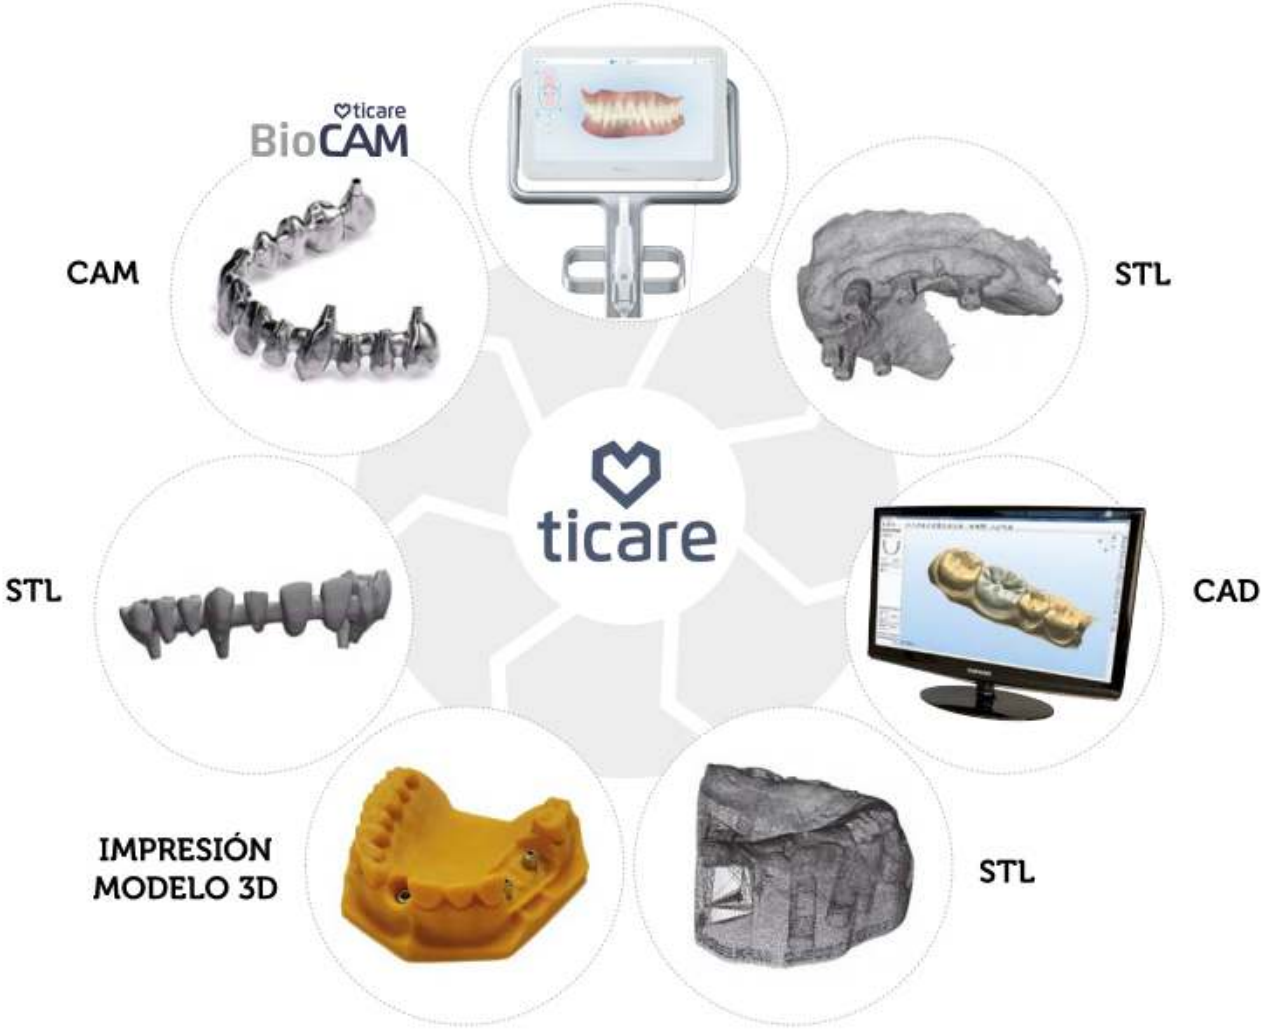

SCANBODIES Y ANÁLOGOS DIGITALES

PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTE CON SU DELEGADO COMERCIAL

ticare BioCAM

Sistema de scanbodies Ticare BioCAM

Los scanbodies BioCAM han sido desarrollados por nuestro departamento de ingeniería e I+D y testados con la última generación de metrología tridimensional. Diseñados y fabricados para facilitar el escaneo, los scanbodies BioCAM están concebidos para una óptima precisión, tanto para uso con escáner intraoral como con escáner de sobremesa, mejorando el posicionamiento tridimensional del plano de trabajo en ambas situaciones. Este conjunto asegura una precisión de escaneo de 0,01 mm.

CE Compliance according to Regulation (EU) 2017/745

Scanbodies directos a implante Ticare BioCAM

REF.	DESCRIPCIÓN		Ø
41236001	Scanbody Inhex MINI directo c/t	(TC 10)	3,4 mm
41236002	Scanbody Inhex STD directo c/t	(TC 11)	4,1 mm
41236003	Scanbody Inhex MAXI directo c/t	(TC 12)	4,1 mm
41636001	Scanbody Inhex MINI directo c/t TCP	(TC 10)	3,4 mm
41636002	Scanbody Inhex STD directo c/t TCP	(TC 11)	4,1 mm
41636003	Scanbody Inhex MAXI directo c/t TCP	(TC 12)	4,1 mm

TCP

CE Compliance according to Regulation (EU) 2017/745

Scanbodies no directos a implante Ticare BioCAM

REF.	DESCRIPCIÓN		Ø
41146000	Scanbody Inhex/Osseous MINI pilar cónico 10°	(TC 2)	3,4 mm
41146004	Scanbody no rot. Inhex STD/MAXI-Osseous STD pilar cónico 10°	(TC 4)	4,1 mm
41146005	Scanbody Inhex STD/MAXI-Osseous STD pilar cónico 30°	(TC 5)	4,1 mm
41146006	Scanbody Inhex STD/MAXI-Osseous STD pilar multiunit	(TC 6)	4,8 mm

CE Compliance according to Regulation (EU) 2017/745

Análogos directos a implante


REF.	DESCRIPCIÓN	Ø
41235541	Análogo digital Inhex MINI	3,3 mm
41235501	Análogo digital Inhex STD	4,1 mm
41235605	Análogo digital Inhex MAXI	5,0 mm

CE Compliance according to Regulation (EU) 2017/745

Análogos no directos a implante

REF.	DESCRIPCIÓN	Ø
41005541	Análogo digital Inhex/Osseous MINI pilar cónico 10°	3,4 mm
41005511	Análogo digital Inhex STD/MAXI-Osseous STD pilar cónico 10°	4,1 mm
41003511	Análogo digital Inhex STD/MAXI-Osseous STD pilar cónico 30°	4,1 mm
41145117	Análogo digital pilar multiunit Inhex STD/MAXI-Osseous STD	4,8 mm

SCANBODIES TICARE BIOCAM

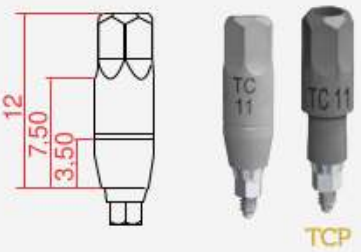

- Material: Titanio grado IV
- Scanbodies de una pieza para uso con escáner intraoral y de sobremesa (Dispone de un tornillo prisionero desmontable después de cada uso para su correcta higiene y mantenimiento)
- Los scanbodies se atornillan con el destornillador hexagonal 1,25 mm a un torque de 3 Ncm.
- Scanbodies esterilizables

ANÁLOGOS DIGITALES TICARE



- Diseño en dos piezas roscadas y amplia superficie de posicionamiento axial, radial y angular para una fácil y precisa colocación en el modelo 3D
- Material: Acero inoxidable



Más información en
www.ticareimplants.com/ticare-biocam

BioCAM

Sólo un ajuste perfecto

cuenta con **gapZero®**



- Prótesis personalizada mecanizada en el centro de fresado Ticare BioCAM para mayor calidad y menor aflojamiento de tornillo.
- Mecanizado especialmente preciso en las conexiones para un ajuste con gapZero libre de filtración bacteriana.

Corrección de angulación para prótesis atornillada Ticare BioCAM

InHex MINI	0° a 15°
InHex STD	0° a 20°
InHex MAXI	0° a 20°
Pilar Multiunit	0° a 30°
Pilar Cónico 10°	0° a 30°
Pilar Cónico 30°	0° a 30°



CORRECCIÓN DE ANGULACIÓN

- Ticare BioCam ofrece la opción de corregir la angulación del orificio de acceso al tornillo en situaciones estéticamente comprometidas.


CE Compliance according to Regulation (EU) 2017/745

Scanbodies directos a implante otras conexiones

REF.	DESCRIPCIÓN	Ø
42028035	Scanbody compatible TCZI Zimmer® 3,5	3,5 mm
42028045	Scanbody compatible TCZ2 Zimmer ® 4,5	4,6 mm
42028057	Scanbody compatible TCZ3 Zimmer ® 5,7	5,8 mm
42018035	Scanbody compatible TCSI Straumann® NNC 3,5	3,4 mm
42018048	Scanbody compatible TCS2 Straumann® Tissue Level RN 4,8	4,1 mm
42018065	Scanbody compatible TCS3 Straumann® Tissue level WN 6,5	5 mm
42018033	Scanbody compatible TCS4 Straumann® Bone level NC	3,4 mm
42018041	Scanbody compatible TCS5 Straumann® Bone level RC	4,1 mm
42038035	Scanbody compatible TCRI Nobel Replace® 3,5	3,5 mm
42038043	Scanbody compatible TCR2 Nobel Replace® 4,3	4,1 mm
42038050	Scanbody compatible TCR3 Nobel Replace® 5,0	5 mm
42038060	Scanbody compatible TCR4 Nobel Replace® 6,0	5,8 mm
42058034	Scanbody compatible TCCI 3i Certain® 3,4	3,4 mm
42058041	Scanbody compatible TCC2 3i Certain® 4,1	4,1 mm
42058050	Scanbody compatible TCC3 3i Certain® 5,0	4,1 mm
42058060	Scanbody compatible TCC4 3i Certain® 6,0	4,1 mm
42039030	Scanbody compatible TCNAI Nobel Active® 3,0	3,4 mm
42039035	Scanbody compatible TCNA2 Nobel Active® 3,5	4,1 mm
42039050	Scanbody compatible TCNA3 Nobel Active® 4,3-5,0	4,1 mm

SCANBODIES DIRECTOS OTRAS CONEXIONES

- Scanbodies para uso con escáner intraoral y de sobremesa.
- Los scanbodies se atornillan con el destornillador hexagonal 1,25 mm a un torque de 3 Ncm.



CE Compliance according to Regulation (EU) 2017/745

Scanbodies no directos a implante otras conexiones

REF.	DESCRIPCIÓN	Ø
42019048	Scanbody compatible TCS6 Straumann Synocta® 4,8	5mm
42048020	Scanbody compatible TCA1 Astra Tech®Pilar recto 20°	3,4 mm
42048045	Scanbody compatible TCA2 Astra Tech®Pilar recto 45°	3,4 mm

SCANBODIES NO DIRECTOS OTRAS CONEXIONES

- Scanbodies para uso con escáner intraoral y de sobremesa.
- Los scanbodies se atornillan con el destornillador hexagonal 1,25 mm a un torque de 3 Ncm.



CE Compliance according to Regulation 0051 (EU) 2017/745 verified by Notified Body

Tornillos BioCAM para tornillos chimeneas anguladas conexión Ticare

REF.	DESCRIPCIÓN	
443010151	Tornillo para chimeneas anguladas Inhex STD M 1,6 L 7,2	
44301452	Tornillo para chimeneas anguladas M 1,4 L5,2	
44301439	Tornillo para chimeneas anguladas M 1,4 L 3,9	
44301467	Tornillo para chimeneas anguladas M 1,4 L 6,7	
44301676	Tornillo para chimeneas anguladas M 1,6 L 7,6 (cabeza 2,1)	
44301678	Tornillo para chimeneas anguladas M 1,6 L 7,8 (cabeza 2)	
44301681	Tornillo para chimeneas anguladas M 1,6 L 8,1	
44301841	Tornillo para chimeneas anguladas M 1,8 L 4,1	
44301857	Tornillo para chimeneas anguladas M 1,8 L 5,7	
44301874	Tornillo para chimeneas anguladas M 1,8 L 7,4	
44302047	Tornillo para chimeneas anguladas M 2 L 4,7	
44302070	Tornillo para chimeneas anguladas M 2 L 7,0	
44302072	Tornillo para chimeneas anguladas M 2 L 7,2 punta esférica	
44302562	Tornillo para chimeneas anguladas M 2,5 L 6,2	

Correspondencias tornillos chimeneas anguladas - conexiones BioCAM

FAB.	PLATAFORMA	TORN. CHIMENEAS ANG.	ANGULACIÓN MAX.
Ticare	Osseous 3,3 MINI - 3,4/3,75/4,25 STD	44302070	0° a 30°
Ticare	Osseous 5,0 MAXI	44302562	0° a 20°
Ticare	Multiunit	44301439	0° a 30°
Ticare	Cónico 10° STD/MAXI NO ROT/ROT	44302047	0° a 30°
Ticare	Cónico 10° MINI ROT	44302047	0° a 30°
Ticare	Cónico 30° STD/MAXI ROT	44302047	0° a 30°
Ticare	Inhex 3,3 MINI NO ROT/ROT	44301467	0° a 15°
Ticare	Inhex 3,3 MINI TCP NO ROT/ROT	No disponible	-
Ticare	Inhex 3,75/4,25 STD NO ROT/ROT	443010151	0° a 20°
Ticare	Inhex 3,75/4,25 STD TCP H2 NO ROT/ROT	44301679	0° a 20°
Ticare	Inhex 3,75/4,25 STD TCP H3-4 NO ROT/ROT	44301698	0° a 20°
Ticare	Inhex 5,0 MAXI NO ROT/ROT	44302070	0° a 20°
Ticare	Inhex 5,0 MAXI TCP H2-3-4 NO ROT/ROT	44302083	0° a 20°
Astra Tech	AstraTech 20° UniAbutment	44301452	0° a 20°
Astra Tech	AstraTech 45° UniAbutment	44301452	0° a 20°
Biomet 3i	3i Micro-Mini	44302070	0° a 30°
Biomet 3i	3i Standard	44302070	0° a 30°
Biomet 3i	3i 5,0	44302070	0° a 30°
Biomet 3i	3i Certain 3,4 NO ROT/ROT	44301676	0° a 20°
Biomet 3i	3i Certain 4,1 NO ROT	44301681	0° a 20°
Biomet 3i	3i Certain 4,1 ROT	44301681	0° a 20°
Biomet 3i	3i Certain 5,0 NO ROT	44301681	0° a 20°
Biomet 3i	3i Certain 5,0 ROT	44301681	0° a 20°
Biomet 3i	3i Certain 6,0 NO ROT	44301681	0° a 20°
Biomet 3i	3i Certain 6,0 ROT	44301681	0° a 20°
Biomet 3i	3i Ceratin Low Profile Abutment	44301439	0° a 30°
Nobel	Nobel Replace 3,5 NP NO ROT/ROT	44301874	0° a 20°
Nobel	Nobel Replace 4,3 RP/5,0 WP/6,0 WP NO ROT/ROT	44302072	0° a 20°
Nobel	Nobel Active NP 3,5 NO ROT/ROT	44301676	0° a 20°
Nobel	Nobel Active RP 4,3/5,0 NO ROT/ROT	44302070	0° a 20°
Nobel	Branemark System NP NO ROT/ROT	44301676	0° a 20°
Nobel	Multi-unit Branemark System WP ROT	44301841	0° a 20°
Straumann	Straumann RN 4,8 Tissue level NO ROT/ROT	44302070	0° a 20°
Straumann	Straumann WN 6,5 Tissue level NO ROT/ROT	44302070	0° a 20°
Straumann	Straumann Bone Level NC NO ROT/ROT	44301681	0° a 20°
Straumann	Straumann Bone Level RC NO ROT/ROT	44301681	0° a 20°
Straumann	Straumann SynOcta 4,8 RN NO ROT/ROT	44302047	0° a 20°
Straumann	Straumann SynOcta 6,5 WN NO ROT/ROT	44302047	0° a 20°
Straumann	Straumann Pilar Roscado TAN 3,5 ROT	44301452	0° a 30°
Straumann	Straumann Pilar Roscado TAN 4,6 ROT	44301452	0° a 30°
Zimmer	Screw-Vent 3,5/4,5 NO ROT	44301857	0° a 20°
Zimmer	Screw-Vent 3,5/4,5 ROT	44301857	0° a 20°
Zimmer	Screw-Vent 5,7 NO ROT/ROT	44301857	0° a 20°

inHEX

SOLO TICARE ES GAPZERO®

Reduce los **micromovimientos**

Elimina los **aflojamientos** de tornillo



GAP ZERO® TECHNOLOGY ticare

Disminuye el riesgo de periimplantitis

Mejora el mantenimiento del hueso marginal

Espira de **doble rosca** que reduce el tiempo de inserción y el calentamiento óseo

Superficie RBM-TC para mayor contacto hueso-implante

Estabilidad **primaria y secundaria**

ticare

ticare
MOVING FOR CARE

PILARES TCP



DA MÁS VOLUMEN A LOS TEJIDOS BLANDOS

Pilar cónico 10º TCP de emergencia estrecha

GAP ZERO® TECHNOLOGY ticare

EL IMPLANTE LIBRE DE FILTRACIÓN BACTERIANA

Implante Ticare **PerioHYBRID**



ticare

inHEX PRÓTESIS

Sistema de Prótesis Inhex®

Guía de prótesis
Tornillos de cicatrización
Postes de impresión
Pilares directos a implante
Pilar para Zirconio
Pilares de bola y pilar Over-Loc
Pilares transepiteliales
Prótesis temporal / Carga inmediata
Tornillos para pilares y postes
Set prostodoncia

Restauraciones plataforma MINI

TORNILLOS DE CIERRE



TCP

23203321 1 mm
23203322 2mm

TORNILLOS DE CICATRIZACIÓN



23203320 2 mm
23203330 3 mm
23203340 4 mm

POSTES DE IMPRESIÓN

[Cubeta abierta]



23203303



23235504 Corto L=14mm
23235502 Largo L=20mm
23235505 Encerado L=29

[Hex] [Cubeta cerrada]



23203324 Corto
23203334 Largo

SCANBODY

[Directo a implante]



41236001 TC10

TCP

TORNILLOS CICATRIZACIÓN



23603320 2 mm
23603330 3 mm
23603340 4mm
23603350 5mm

POSTES IMPRESIÓN



[Hex] [Cubeta abierta]
23603303



[Hex] [Cubeta cerrada]
23603324 Corto
23603334 Largo

SCANBODY



[Directo a implante]
41636001 TC10

ATORNILLADAS

UNITARIAS

BIOCAM



Prótesis personalizada mecanizada en el centro de fresado Ticare

INTERFASE DE TITANIO HEXAGONAL PARA ZIRCONIO



[Hex]
23237905 0,5 mm
23237910 1 mm
23237920 2 mm
23237930 3 mm



TCP
[Hex]
23637920 2 mm
23637930 3 mm

INTERFASE DINÁMICA HEXAGONAL PARA ZIRCONIO



[Hex]
23237705 0,5 mm
23237710 1 mm
23237720 2 mm
23237730 3 mm



TCP
[Hex]
23637720 2 mm
23637730 3 mm

MÚLTIPLES

INTERFASE DE TITANIO ROTATORIA PARA ZIRCONIO



[Rot]
23237805 0,5 mm
23237810 1 mm
23237820 2 mm
23237830 3 mm



TCP
[Rot]
23637820 2 mm
23637830 3 mm

INTERFASE DINÁMICA ROTATORIA PARA ZIRCONIO



[Rot]
23237605 0,5 mm
23237610 1 mm
23237620 2 mm
23237630 3 mm



TCP
[Rot]
23637620 2 mm
23637630 3 mm

MÚLTIPLES

PILAR CÓNICO 10º



[Rot]
23201031 10° 1 mm
23201032 10° 2 mm
23201033 10° 3 mm



TCP
[Rot]
23601032 10° 2 mm
23601033 10° 3 mm

ELEMENTOS


13203313 Poste de impresión


41146000 Scanbody (TC2)



13203310 Tornillo cicatrización


13205551 Análogo

41005541 Análogo digital


13209233 Cilindro titanio


13209133 Cilindro calcinable


13236110 Cilindro temporal tit.


13235110 Cilindro temp. calcin.


13237902 Interfase p cónico 10°


13237602 Interf. dinámica p cónico 10°

CEMENTADAS

PILARES

BIOCAM



Prótesis personalizada mecanizada en el centro de fresado Ticare

FIJO



[Hex]
23207031 1 mm
23207032 2 mm
23207033 3 mm



TCP
[Hex]
23607032 2 mm
23607033 3 mm

ANGULADO



[Hex]
23231015 15° 2 mm
23231020 20° 2 mm

INTERFASE DE TITANIO PARA ZIRCONIO



[Hex]
23237905 0,5 mm
23237910 1 mm
23237920 2 mm
23237930 3 mm



TCP
[Hex]
23637920 2 mm
23637930 3 mm

INTERFASE DINÁMICA PARA ZIRCONIO



[Hex]
23237705 0,5 mm
23237710 1 mm
23237720 2 mm
23237730 3 mm



TCP
[Hex]
23637720 2 mm
23637730 3 mm

TEMPORALES

PILARES

FIJO



[Hex]
23232110 2 mm

ANÁLOGO



23205541

ANÁLOGO DIGITAL



41235541

TORNILLOS DE RETENCIÓN


23232526 Tornillo hexagonal
232310151 Tornillo de pilar angulado
13202528 Tornillo prótesis pilar cónico

TCP

23632526 Tornillo hexagonal H2-3

Restauraciones plataforma STD

TORNILLOS DE CIERRE



TCP

23205021 1 mm
23205022 2 mm
23205023 3 mm

TORNILLOS DE CICATRIZACIÓN



Ø 4

23204810 1 mm
23204820 2 mm
23204830 3 mm
23204840 4 mm
23204850 5 mm
23204870 7 mm



Ø 5

23206036 3 mm
23206046 4 mm
23206056 5 mm
23206076 7 mm



Ø 6

ESTÉTICO

23206030 3 mm
23206040 4 mm
23206050 5 mm
23206070 7 mm

SCANBODY



[Directo a implante]
41236002 TC11

POSTES DE IMPRESIÓN



[No hex] [Cubeta abierta]
23205503 Corto
23205403 Largo
23205506 Estético



23205504 Corto L=14 mm
23205502 Largo L=20 mm
23205505 Encerado L=29 mm



[Hex] [Cubeta cerrada]
23203724 Corto
23203734 Largo



[No hex] [Cubeta cerrada]
23205600 Corto
23205606 Largo
23205603 Estético

TCP

TORNILLOS CICATRIZACIÓN



23604820 2 mm
23604830 3 mm
23604840 4 mm
23604850 5 mm

POSTES IMPRESIÓN



[Hex] [Cubeta abierta]
23605503



[Hex] [Cubeta cerrada]
23603724 Corto
23603734 Largo

SCANBODY



[Directo a implante]
41636002 TC11

ATORNILLADAS

UNITARIAS

BIOCAM



Prótesis personalizada mecanizada en el centro de fresado Ticare

INTERFASE DE TITANIO CEREC®



23207990 0 mm
23207991 1 mm
23207992 2 mm
23207993 3 mm
23207994 4 mm

INTERFASE DE TITANIO PARA ZIRCONIO [Hex]



23207905 0,5 mm
23207910 1 mm
23207920 2 mm
23207930 3 mm

TCP



H2 H3-4

23607920 2 mm
23607930 3 mm
23607940 4 mm

INTERFASE DINÁMICA PARA ZIRCONIO [Hex]



23207705 0,5 mm
23207710 1 mm
23207720 2 mm
23207730 3 mm



23607720 2 mm
23607730 3 mm
23607740 4 mm

MÚLTIPLES

INTERFASE DE TITANIO PARA ZIRCONIO



23207805 0,5 mm
23207810 1 mm
23207820 2 mm
23207830 3 mm

TCP



23607820 2 mm
23607830 3 mm
23607840 4 mm

INTERFASE DINÁMICA PARA ZIRCONIO [Rot]



23207605 0,5 mm
23207610 1 mm
23207620 2 mm
23207630 3 mm

TCP



23607620 2 mm
23607630 3 mm
23607640 4 mm

MÚLTIPLES

*El pilar cónico de 10º también se puede utilizar para rehabilitaciones unitarias

*PILAR CÓNICO 10º



23201000 10° 0 mm
23201001 10° 1 mm
23201002 10° 2 mm
23201003 10° 3 mm
23201004 10° 4 mm
23201005 10° 5 mm

TCP



23601002 10° 2 mm
23601003 10° 3 mm
23601004 10° 4 mm
23601005 10° 5 mm



CILINDROS
[Rot]
13209151 10° Calcinable [blanco]
13209251 10° Titanio
[No Rot]
13209152 10° Calcinable [rojo]
13209252 10° Titanio



CILINDROS TEMPORALES
[Rot]
13206110 10° Titanio



INTERFASES TITANIO PARA ZIRCONIO
[Rot]
13207902 10°
[No rot]
13207952 10°



INTERFASES DINÁMICAS PARA ZIRCONIO
[Rot]
13207602 10°
[No Rot]
13207652 10°



SCANBODY
41146004 10° TC4



TORNILLO CICATRIZACIÓN
13201000 10° (Baja)
13201010 10° (Alta)



POSTES IMPRESIÓN
[No Rot] [Cubeta abierta]
13205213 10° [púrpura]
[Rot] [Cubeta abierta]
13205513 10° Titanio
[Rot] [Cubeta cerrada]
13205613 10° Titanio



ANÁLOGO
13205511 10°



ANÁLOGO DIGITAL
41005511 10°

PILAR CÓNICO 30º



23203001 30° 1 mm
23203002 30° 2 mm
23203003 30° 3 mm
23203004 30° 4 mm
23203005 30° 5 mm

TCP



23603002 30° 2 mm
23603003 30° 3 mm
23603004 30° 4 mm
23603005 30° 5 mm



CILINDROS
[Rot]
13209153 30° Calcinable [blanco]
13209253 30° Titanio



CILINDROS TEMPORALES
13206130 30° Titanio



INTERFASES TITANIO PARA ZIRCONIO
[Rot]
13207953 30°



INTERFASES DINÁMICAS PARA ZIRCONIO
[Rot]
13207653 30°



SCANBODY
41146005 30° TC5



TORNILLO CICATRIZACIÓN
13201300 30° (Baja)
13201310 30° (Alta)



POSTES IMPRESIÓN
[Rot] [Cubeta abierta]
13205530 30° Titanio
[Rot] [Cubeta cerrada]
13205630 30° Titanio



ANÁLOGO
13203511 30°



ANÁLOGO DIGITAL
41003511 30°

MULTIUNIT

RECTO
[No hex]



23209901 1 mm
23209902 2 mm
23209903 3 mm
23209904 4 mm
23209905 5 mm

TCP



23609902 2 mm
23609903 3 mm
23609904 4 mm
23609905 5 mm

ANGULADO
[Hex]



23201720 17° 2 mm
23201730 17° 3 mm
23201740 17° 4 mm



23203030 30° 3 mm
23203040 30° 4 mm
23203050 30° 5 mm

CILINDROS
[Rot]



13209117 Titanio
13201751 Calcinable

CILINDROS TEMPORALES



13206710 Titanio
13205710 Calcinable

INTERFASES TITANIO PARA ZIRCONIO
[Rot]



13207917

INTERFASES DINÁMICAS PARA ZIRCONIO
[Rot]



13207617

TORNILLO CICATRIZACIÓN



13201017 (Baja)
13201027 (Alta)

SCANBODY



41146006 TC6

POSTES IMPRESIÓN
[Rot] [Cubeta abierta]
13205217



[Rot] [Cubeta cerrada]
13205617

ANÁLOGO



13205117

ANÁLOGO DIGITAL



41145117

CEMENTADAS

PILARES

BIOCAM



Prótesis personalizada mecanizada en el centro de fresado Ticare

FIJO



[Hex] Ø 4

23207000	0 mm
23207010	1 mm
23207012	2 mm
23207013	3 mm
23207014	4 mm



[Hex] Ø 5

23207613	3 mm
23207614	4 mm



[Hex] Ø 6 ESTÉTICO

23207513	3 mm
23207514	4 mm



H2 H3-4

TCP [Hex]

23607012	2 mm
23607013	3 mm
23607014	4 mm

ANGULADO



[Hex] Ø 4

23201015	15°	1 mm
23201315	15°	3 mm
23201515	15°	5 mm
23201020	20°	1 mm
23201320	20°	3 mm
23201520	20°	5 mm



[Hex] Ø 5

23206015	15°	1 mm
23206315	15°	3 mm
23206515	15°	5 mm
23206020	20°	1 mm
23206320	20°	3 mm
23206520	20°	5 mm

INTERFASE DE TITANIO CEREC®



23207990	0 mm
23207991	1 mm
23207992	2 mm
23207993	3 mm
23207994	4 mm

INTERFASE DE TITANIO PARA ZIRCONIO



[Hex]

23207905	0,5 mm
23207910	1 mm
23207920	2 mm
23207930	3 mm

TCP [Hex]



H2 H3-4

23607920	2 mm
23607930	3 mm
23607940	4 mm

INTERFASE DINÁMICA PARA ZIRCONIO



[Hex]

23207705	0,5 mm
23207710	1 mm
23207720	2 mm
23207730	3 mm

TCP [Hex]



23607720	2 mm
23607730	3 mm
23607740	4 mm

REMOVIBLES

PILARES

PILAR DE BOLA



23208610	1 mm
23208620	2 mm
23208630	3 mm
23208640	4 mm
23208650	5.5 mm



*Retención de VESTA KEEP® PEEK incluida. Ref 13208600

OVER-LOC



23209681	1 mm
23209682	2 mm
23209683	3 mm
23209684	4 mm
23209685	5 mm



13209589 Over- Loc para barra 2mm

ACCESORIOS OVER-LOC



19008530 Análogo (4 uds)



19008505 Poste de impresión (4 uds)



19008519 Pack de procesado (2 uds)



190080282 Pack de procesado Locator® para barra (2 uds)

ANÁLOGO DIGITAL



41235501 Análogo digital

ANÁLOGO



23205501 Análogo



23285501 Análogo llave prótesis



13205521 Análogo pilar de bola

TEMPORALES

PILARES

UCLA



[Hex] [Rojo]
23208151 Calcinable

[No Hex] [Blanco]
23207151 Calcinable



[Hex]
23204110 Titanio

[No Hex]
23205110 Titanio

FIJO



[Hex]
23202110 2 mm

[No Hex]
23203110 2 mm

* Plastic cap incluido

TORNILLOS DE RETENCIÓN

DIRECTOS A IMPLANTE



23202526 Tornillo hexagonal



23202508 Tornillo de ranura



443010151 BioCam chimeneas ang.



232010151 Tornillo de pilar angulado



23201726 Tornillo de Multiunit angulado

TCP



23602516 Tornillo hexagonal TCP H2



23602526 Tornillo hexagonal TCP H3-4

NO DIRECTOS A IMPLANTE



13202528 Tornillo para prótesis p. cónico



13201727 Tor. para prótesis p. Multiunit



13201728 Tor. perfil bajo prót. Multiunit

LABORATORIO



23282526 Tornillo de laboratorio (5 uds)

TCP



23682516 Tornillo retención Laboratorio H2

23682526 Tornillo retención Laboratorio H3-H4

Restauraciones plataforma MAXI

TORNILLOS DE CIERRE



TCP

23205031 1 mm
23205032 2mm
23205033 3mm

TORNILLOS DE CICATRIZACIÓN



Ø 4

23205020 2 mm
23205030 3 mm
23205040 4 mm
23205050 5 mm
23205070 7 mm



Ø 5

23206536 3 mm
23206546 4 mm
23206556 5 mm
23206576 7 mm



Ø 6

ESTÉTICO

23206530 3 mm
23206540 4 mm
23206550 5 mm
23206570 7 mm

SCANBODY



[Directo a implante]

41236003 TC12

POSTES DE IMPRESIÓN



[Cubeta abierta]

23205003 Corto
23205007 Largo
23255403 Estético



23205004 Corto L=14mm
23205002 Largo L=20mm
23205005 Encerado L=29 mm



[Hex] [Cubeta cerrada]

23205024 Corto
23205034 Largo



[No Hex] [Cubeta cerrada]

23205056 Estándar
23205066 Largo
23205306 Estético

TCP



TORNILLOS CICATRIZACIÓN

23605020 2 mm
23605030 3 mm
23605040 4 mm
23605050 5 mm



POSTES IMPRESIÓN

[Hex] [Cubeta abierta]

23605003



[Hex] [Cubeta cerrada]

23605024 Corto
23605034 Largo



SCANBODY

[Directo a implante]

41636003 TC12

ATORNILLADAS

UNITARIAS



Prótesis personalizada mecanizada en el centro de fresado Ticare

INTERFASE DE TITANIO CEREC®



23257990 0 mm
23257991 1 mm
23257992 2 mm
23257993 3 mm
23257994 4 mm

INTERFASE DE TITANIO PARA ZIRCONIO [Hex]



23257905 0,5 mm
23257910 1 mm
23257920 2 mm
23257930 3 mm

TCP



23657920 2 mm
23657930 3 mm
23657940 4 mm

INTERFASE DINÁMICA PARA ZIRCONIO [Hex]



23257705 0,5 mm
23257710 1 mm
23257720 2 mm
23257730 3 mm

TCP



23657720 2 mm
23657730 3 mm
23657740 4 mm

MÚLTIPLES

INTERFASE DE TITANIO PARA ZIRCONIO



23257805 0,5 mm
23257810 1 mm
23257820 2 mm
23257830 3 mm

TCP



23657820 2 mm
23657830 3 mm
23657840 4 mm

INTERFASE DINÁMICA PARA ZIRCONIO [Rot]



23257605 0,5 mm
23257610 1 mm
23257620 2 mm
23257630 3 mm

TCP



23657620 2 mm
23657630 3 mm
23657640 4 mm

MÚLTIPLES

*El pilar cónico de 10º también se puede utilizar para rehabilitaciones unitarias

*PILAR CÓNICO 10º



23201050 10° 0 mm
23201051 10° 1 mm
23201052 10° 2 mm
23201053 10° 3 mm
23201054 10° 4 mm
23201055 10° 5 mm

TCP



23601052 10° 2 mm
23601053 10° 3 mm
23601054 10° 4 mm
23601055 10° 5 mm

CILINDROS

[Rot]
13209151 10° Calcinable
13209251 10° Titanio
[No Rot]
13209152 10° Calcinable [rojo]
13209252 10° Titanio

CILINDROS TEMPORALES

[Rot]
13206110 10° Titanio

INTERFASES TITANIO PARA ZIRCONIO

[Rot]
13207902 10°
[No rot]
13207952 10°

INTERFASES DINÁMICAS PARA ZIRCONIO

[Rot]
13207602 10°
[No Rot]
13207652 10°

SCANBODY

41146004 10° TC4

TORNILLO CICATRIZACIÓN

13201000 10° (Baja)
13201010 10° (Alta)

POSTES IMPRESIÓN

[No Rot] [Cubeta abierta]
13205213 10° [púrpura]
[Rot] [Cubeta abierta]
13205513 10° Titanio
[Rot] [Cubeta cerrada]
13205613 10° Titanio

ANÁLOGO

13205511 10°

ANÁLOGO DIGITAL

41005511 10°

PILAR CÓNICO 30º



23253001 30° 1 mm
23253002 30° 2 mm
23253003 30° 3 mm
23253004 30° 4 mm
23253005 30° 5 mm

TCP



23653002 30° 2 mm
23653003 30° 3 mm
23653004 30° 4 mm
23653005 30° 5 mm

CILINDROS

[Rot]
13209153 30° Calcinable [blanco]
13209253 30° Titanio

CILINDROS TEMPORALES

13206130 30° Titanio

INTERFASES TITANIO PARA ZIRCONIO

[Rot]
13207953 30°

INTERFASES DINÁMICAS PARA ZIRCONIO

[Rot]
13207653 30°

SCANBODY

41146005 30° TC5

TORNILLO CICATRIZACIÓN

13201300 30° (Baja)
13201310 30° (Alta)

POSTES IMPRESIÓN

[Rot] [Cubeta abierta]
13205530 30° Titanio
[Rot] [Cubeta cerrada]
13205630 30° Titanio

ANÁLOGO

13203511 30°

ANÁLOGO DIGITAL

41003511 30°

MULTIUNIT

RECTO
[No hex]



23259901 1 mm
23259902 2 mm
23259903 3 mm
23259904 4 mm
23259905 5 mm

TCP



23659902 2 mm
23659903 3 mm
23659904 4 mm
23659905 5 mm

ANGULADO
[Hex]



23251720 17° 2 mm
23251730 17° 3 mm
23251740 17° 4 mm
23253030 30° 3 mm
23253040 30° 4 mm
23253050 30° 5 mm

CILINDROS

[Rot]
13209117 Titanio
13201751 Calcinable [Blanco]

CILINDROS TEMPORALES

13206710 Titanio
13205710 Calcinable

INTERFASES TITANIO PARA ZIRCONIO

[Rot]
13207917

INTERFASES DINÁMICAS PARA ZIRCONIO

[Rot]
13207617

TORNILLO CICATRIZACIÓN

13201017 (Baja)
13201027 (Alta)

SCANBODY

41146006 TC6

POSTES IMPRESIÓN

[Rot] [Cubeta abierta]
13205217
[Rot] [Cubeta cerrada]
13205617

ANÁLOGO

13205117

ANÁLOGO DIGITAL

41145117

CEMENTADAS

PILARES

BioCam



Prótesis personalizada mecanizada en el centro de fresado Ticare

FIJO



[Hex] Ø 4

23207050	0 mm
23207051	1 mm
23207052	2 mm
23207053	3 mm
23207054	4 mm



[Hex] Ø 5

23257613	3 mm
23257614	4 mm



[Hex] Ø 6 ESTÉTICO

23257513	3 mm
23257514	4 mm



TCP [Hex]

23607052	2 mm
23607053	3 mm
23607054	4 mm

ANGULADO



[Hex] Ø 4

23251015	15°	1 mm
23251315	15°	3 mm
23251515	15°	5 mm
23251020	20°	1 mm
23251320	20°	3 mm
23251520	20°	5 mm



[Hex] Ø 5

23256015	15°	1 mm
23256315	15°	3 mm
23256515	15°	5 mm
23256020	20°	1 mm
23256320	20°	3 mm
23256520	20°	5 mm

INTERFASE DE TITANIO CEREC®



23257990	0 mm
23257991	1 mm
23257992	2 mm
23257993	3 mm
23257994	4 mm

INTERFASE DE TITANIO PARA ZIRCONIO



[Hex]

23257905	0,5 mm
23257910	1 mm
23257920	2 mm
23257930	3 mm

TCP [Hex]



23657920	2 mm
23657930	3 mm
23657940	4 mm

INTERFASE DINÁMICA PARA ZIRCONIO



[Hex]

23257705	0,5 mm
23257710	1 mm
23257720	2 mm
23257730	3 mm



TCP [Hex]

23657720	2 mm
23657730	3 mm
23657740	4 mm

REMOVIBLES

PILARES

PILAR DE BOLA



23258610	1 mm
23258620	2 mm
23258630	3 mm
23258640	4 mm
23258655	5.5 mm



*Retención de VESTA KEEP® PEEK incluida. Ref 13208600

OVER-LOC



23259681	1 mm
23259682	2 mm
23259683	3 mm
23259684	4 mm
23259685	5 mm



13209589 Over- Loc® para barra 2mm

ACCESORIOS OVER-LOC



19008530 Análogo (4 uds)



19008505 Poste de impresión (4 uds)



19008519 Pack de procesado (2 uds)



190080282 Pack de procesado Locator® para barra (2 uds)

ANÁLOGO DIGITAL



41235605 Análogo digital

ANÁLOGO



23205605 Análogo

23285605 Análogo llave prótesis



13205521 Análogo pilar de bola

TEMPORALES

PILARES

UCLA



[Hex] [Rojo]
23208155 Calcinable

[No Hex] [Blanco]
23207155 Calcinable



[Hex]
23254110 Titanio

[No Hex]
23255110 Titanio

FIJO



[Hex]
23252110 2 mm

[No Hex]
23253110 2 mm

* Plastic cap incluido

TORNILLOS DE RETENCIÓN

DIRECTOS A IMPLANTE



23205025 Tornillo hexagonal



23202509 Tornillo de ranura



44302070 BioCam chimeneas ang.



232510151 Tornillo de pilar angulado



23251726 Tor. de Multiunit angulado

TCP



23205025 Tornillo hexagonal

NO DIRECTOS A IMPLANTE



13202528 Tornillo para prótesis p. cónico



13201727 Tor. para prótesis p. Multiunit



13201728 Tor. perfil bajo prót. Multiunit

LABORATORIO



23285025 Tornillo de laboratorio (5 uds)



Tornillo cierre TCP

CE 0051 Compliance according to Regulation (EU) 2017/745 verified by Notified Body

ALTURA (H)	MINI	STD	MAXI
1 mm	23203321	23205021	23205031
2 mm	23203322	23205022	23205032
3 mm	-	23205023	23205033



TORNILLO DE CIERRE TCP

- Material: Titanio grado V
- Destornillador hexagonal de 1,25 mm

MINI:
- Plataforma: 2,3 mm
- Ø: 2,3 mm

STD:
- Plataforma: 2,8 mm
- Ø: 2,8 mm

MAXI:
- Plataforma: 3,8 mm
- Ø: 3,8 mm

Recomendaciones:
- Torque máximo 10 Ncm

Tornillo cicatrización Ø 4 mm

CE 0051 Compliance according to Regulation (EU) 2017/745 verified by Notified Body

ALTURA (H)	MINI	STD	MAXI
1 mm	-	23204810	-
2 mm	23203320	23204820	23205020
3 mm	23203330	23204830	23205030
4 mm	23203340	23204840	23205040
5 mm	-	23204850	23205050
7 mm	-	23204870	23205070



TORNILLO DE CICATRIZACIÓN Ø 4 mm

- Material: Titanio grado V
- Destornillador hexagonal de 1,25 mm

MINI:
- Plataforma: 2,3 mm
- Ø: 3,4 mm

STD:
- Plataforma: 2,8 mm
- Ø: 4,0 mm

MAXI:
- Plataforma: 3,8 mm
- Ø: 4,0 mm

Recomendaciones:
- El tornillo de cicatrización debe sobresalir 2 mm por encima de la encía
- Torque máximo 10 Ncm

Tornillo cicatrización Ø 5 mm

CE 0051 Compliance according to Regulation (EU) 2017/745 verified by Notified Body

ALTURA (H)	MINI	STD	MAXI
3 mm	-	23206036	23206536
4 mm	-	23206046	23206546
5 mm	-	23206056	23206556
7 mm	-	23206076	23206576



TORNILLO DE CICATRIZACIÓN Ø 5 mm

- Material: Titanio grado V
- Destornillador hexagonal de 1,25 mm

STD:
- Plataforma: 2,8 mm
- Ø: 5,0 mm

MAXI:
- Plataforma: 3,8 mm
- Ø: 5,0 mm

Recomendaciones:
- El tornillo de cicatrización debe sobresalir 2 mm por encima de la encía
- Torque máximo 10 Ncm

Tornillo cicatrización Ø 6 mm

CE 0051 Compliance according to Regulation (EU) 2017/745 verified by Notified Body

ALTURA (H)	MINI	STD	MAXI
3 mm	-	23206030	23206530
4 mm	-	23206040	23206540
5 mm	-	23206050	23206550
7 mm	-	23206070	23206570



TORNILLO DE CICATRIZACIÓN Ø 6 mm

- Material: Titanio grado V
- Destornillador hexagonal de 1,25 mm

STD:
- Plataforma: 2,8 mm
- Ø: 6,0 mm

MAXI:
- Plataforma: 3,8 mm
- Ø: 6,0 mm

Recomendaciones:
- El tornillo de cicatrización debe sobresalir 2 mm por encima de la encía
- Torque máximo 10 Ncm

ticare

inHEX PRÓTESIS



Tornillo cicatrización TCP

CE Compliance according to Regulation 0051 (EU) 2017/745 verified by Notified Body

ALTURA (H)	MINI	STD	MAXI
2 mm	23603320	23604820	23605020
3 mm	23603330	23604830	23605030
4 mm	23603340	23604840	23605040
5 mm	23603350	23604850	23605050



TORNILLO DE CICATRIZACIÓN TCP

- Material Titanio grado V
- Emergencia TCP
- Destornillador hexagonal de 1,25

MINI Plataforma 2,30 mm ø 3,7 mm
STD Plataforma 2,80 mm ø 4,5 mm
MAXI Plataforma 3,80 mm ø 4,5 mm

Recomendaciones:
- El tornillo de cicatrización debe sobresalir 2 mm por encima de la encía
- Torque máximo 10 Ncm

Postes de impresión cubeta abierta

CE Compliance according to Regulation (EU) 2017/745

[Hex] ALTURA (H)	MINI	STD	MAXI
CORTO	23203303	23205503	23205003
ESTÉTICO	-	23205506	23255403
LARGO	-	23205403	23205007



POSTE IMPRESIÓN HEX INHEX MINI | POSTE IMPRESIÓN HEX INHEX STD | POSTE IMPRESIÓN HEX INHEX MAXI

POSTE DE IMPRESIÓN CUBETA ABIERTA

- Material Acero inoxidable
- Destornillador hexagonal de 1,25 mm

MINI:
- Plataforma 2,3 mm
- Incluye tornillo. Ref: 23235502
- Ø 3,3 mm L=13 mm A=11 mm

STD:
- Plataforma 2,8 mm
- Incluye tornillo Ref: 23205502
- Poste de Impresión Hex: Ø: 4,0 mm L= 13,5 mm A= 11 mm
- Poste de Impresión Hex. estético: Ø: 6,0 mm L= 13,5 mm A= 11 mm
- Poste de Impresión Hex. largo: Ø: 4,1 mm. L= 17 mm. A= 15 mm

MAXI:
- Plataforma 3,8 mm
- Incluye tornillo Ref: 23205002
- Poste de Impresión Hex: Ø: 4 mm L= 15 mm A= 11 mm
- Poste de Impresión Hex. estético: Ø: 6,0 mm L= 15 mm A= 11 mm
- Poste de Impresión Hex. largo: Ø: 4 mm L= 18,5 mm A= 15 mm

Recomendaciones:
- Para restauraciones unitarias o múltiples
- Torque máximo 10 Ncm

Postes de impresión cubeta abierta TCP

CE Compliance according to Regulation (EU) 2017/745

[Hex] DESCRIPCIÓN	MINI	STD	MAXI
CORTO	23603303	23605503	23605003



POSTE IMPRESIÓN HEX INHEX MINI TCP | POSTE IMPRESIÓN HEX INHEX STD TCP | POSTE IMPRESIÓN HEX INHEX MAXI TCP

POSTE DE IMPRESIÓN CUBETA ABIERTA TCP

- Material acero inoxidable
- Destornillador Hexagonal de 1,25 mm

MINI
- Plataforma 2,3 mm
- Incluye tornillo Ref. 23635502
- Ø 5 mm L=13,5 mm A=11 mm

STD
-Plataforma 2,8 mm
- Incluye tornillo Ref. 23605502
- Ø 4 mm L=13,5 mm A=11 mm

MAXI
- Plataforma 3,8 mm
- Incluye tornillo 23205002
- Ø 4 mm L=15 mm A=11 mm

Recomendaciones:
- Para restauraciones unitarias o múltiples
- Torque máximo 10 Ncm



ticare
inHEX
PRÓTESIS

Postes de impresión cubeta cerrada

CE Compliance according to Regulation (EU) 2017/745

	DESCRIPCIÓN	MINI	STD	MAXI
[Hex]	CORTO	23203324	23203724	23205024
	LARGO	23203334	23203734	23205034
[No Hex]	CORTO		23205600	23205056
	ESTÉTICO	-	23205603	23205306
	LARGO	-	23205606	23205066



POSTE IMPRESIÓN HEX INHEX MINI CORTO



POSTE IMPRESIÓN HEX INHEX STD CORTO



POSTE IMPRESIÓN HEX INHEX MAXI CORTO



POSTE IMPRESIÓN HEX INHEX MINI LARGO



POSTE IMPRESIÓN HEX INHEX STD LARGO



POSTE IMPRESIÓN HEX INHEX MAXI LARGO

POSTE DE IMPRESIÓN CUBETA CERRADA

- Material Acero inoxidable
- Destornillador hexagonal de 1,25 mm

MINI:
- Plataforma 2,3 mm
- Poste de impresión corto:
  Ø 3,3 mm L= 13 mm A= 11 mm
- Poste de impresión largo:
  Ø 3,3 mm L= 20,50 mm A= 18 mm

STD:
- Plataforma 2,8 mm
- Poste de impresión corto:
  Ø 4,1 mm L= 13,50 mm A= 11 mm
- Poste de impresión largo:
  Ø 4,1 mm L= 20,50 mm A= 18 mm

MAXI:
- Plataforma 3,8 mm
- Poste de impresión corto:
  Ø 4,1 mm L= 15 mm A= 11 mm
- Poste de impresión largo:
  Ø 4,1 mm L= 22 mm A= 18 mm

Recomendaciones:
- Para restauraciones unitarias o múltiples
- Torque máximo 10 Ncm

Postes de impresión cubeta cerrada TCP

CE Compliance according to Regulation (EU) 2017/745

DESCRIPCIÓN	MINI	STD	MAXI
CORTO	23603324	23603724	23605024
LARGO	23603334	23603734	23605034



POSTE IMPRESIÓN TCP INHEX MINI CORTO



POSTE IMPRESIÓN TCP INHEX STD CORTO



POSTE IMPRESIÓN TCP INHEX MAXI CORTO



POSTE IMPRESIÓN TCP INHEX MINI LARGO



POSTE IMPRESIÓN TCP INHEX STD LARGO



POSTE IMPRESIÓN TCP INHEX MAXI LARGO

POSTE DE IMPRESIÓN CUBETA CERRADA TCP

- Material Acero inoxidable
- Emergencia TCP
- Destornillador hexagonal 1,25 mm
- Incluye tornillo

MINI:
- Plataforma 2,3 mm
- Poste de impresión corto:
  Ø: 3,4 mm L=13,5 mm A=11 mm
- Poste de impresión largo:
  Ø 3,4 mm L= 20,50 mm A= 18 mm

STD:
- Plataforma 2,8 mm
- Poste de impresión corto:
  Ø: 4,1 mm L= 13,50 mm A= 11 mm
- Poste de impresión largo:
  Ø 4,1 mm L= 20,50 mm A= 18 mm

MAXI:
- Plataforma 3,8 mm
- Poste de impresión corto:
  Ø 4,1 mm L= 15 mm A= 11 mm
- Poste de impresión largo:
  Ø 4,1 mm L= 22 mm A= 18 mm

Recomendaciones:
- Para restauraciones unitarias o múltiples
- Torque máximo 10 Ncm



Análogos

CE Compliance according to Regulation (EU) 2017/745

	MINI	STD	MAXI
Análogo implante	23205541	23205501	23205605
Análogo digital	41235541	41235501	41235605
Análogo llave	-	23285501	23285605




Interfase de titanio para CEREC®

CE 0051 Compliance according to Regulation (EU) 2017/745 verified by Notified Body

[Hex]

ALTURA (H)	MINI	STD	MAXI
0,5 mm	-	23207990	23257990
1 mm	-	23207991	23257991
2 mm	-	23207992	23257992
3 mm	-	23207993	23257993
4 mm	-	23207994	23257994



Interfase de titanio hexagonal para zirconio

CE 0051 Compliance according to Regulation (EU) 2017/745 verified by Notified Body

[Hex]

ALTURA (H)	MINI	STD	MAXI
0,5 mm	23237905	23207905	23257905
1 mm	23237910	23207910	23257910
2 mm	23237920	23207920	23257920
3 mm	23237930	23207930	23257930



ANÁLOGOS

- Material Acero inoxidable

MINI:
- Plataforma 2,3 mm
- Ø 3,3 mm

STD:
- Plataforma 2,8 mm
- Ø: 4,0 mm

MAXI:
- Plataforma 3,8 mm
- Ø: 5,0 mm

Análogos para modelo de escayola:
- Diseño en una pieza, altamente retentivo.
- Un solo uso

Análogos digitales:
- Diseño en dos piezas roscadas y amplia superficie de posicionamiento axial, radial y angular para una fácil y precisa colocación en el modelo 3D

Análogo llave
- Para sujetar y retocar cómodamente el pilar o la corona tanto en clínica como en laboratorio

INTERFASE DE TITANIO PARA CEREC

- Material Titanio grado V
- Destornillador hexagonal de 1,25 mm
- Para realizar restauraciones personalizadas en zirconio
- Para restauraciones unitarias atornilladas
- Altura gingival (H) desde 0 hasta 4 mm
- Incluye el tornillo de pilar: STD Ref: 23202526; MAXI Ref: 23205025
- Compatibilidad de la librería digital CEREC® de Sirona, Ref. 901-8317. Scanbody no incluido

Recomendaciones
- Torque: 30 Ncm

INTERFASE DE TIT. HEX. PARA ZIRCONIO

- Material Titanio grado V
- Altura gingival (H) desde 0,5 hasta 3 mm. L= 4mm
- Ø: 3,7 mm (Mini); 4,5 (Std y Maxi)
- Destornillador hexagonal de 1,25 mm
- Para realizar restauraciones personalizadas en zirconio y otros materiales
- Para restauraciones unitarias
- Toma de impresión: Consulte scanbodies pág. 25
- Librerías disponibles para ExoCad®, 3Shape® y Dentalwings®
- Incluye el tornillo de pilar: MINI Ref: 23232526; STD Ref: 23202526 y MAXI Ref: 23205025

Recomendaciones:
- Torque MINI: 20 Ncm
- Torque STD Y MAXI:30 Ncm



Interfase dinámica hexagonal para zirconio

CE Compliance according to Regulation 0051 (EU) 2017/745 verified by Notified Body

[Hex]

ALTURA (H)	MINI	STD	MAXI
0,5 mm	23237705	23207705	23257705
1 mm	23237710	23207710	23257710
2 mm	23237720	23207720	23257720
3 mm	23237730	23207730	23257730



INTERFASE DIN. HEX. PARA ZIRCONIO

- Material Titanio grado V
- Altura gingival (H) desde 0,5 hasta 3 mm. L= 4
- Ø:3,7 (Mini); 4,5 (Std y Maxi)
- Destornillador dinámico
- Para realizar restauraciones personalizadas en zirconio
- Para restauraciones unitarias atornilladas
- Toma de impresión: Consulte scanbodies pág. 25
- Librerías disponibles para ExoCad®, 3Shape® y Dentalwings®
- Incluye el tornillo de interfase. Ver tabla página 60

Recomendaciones:
- Torque MINI: 20 Ncm
- Torque STD Y MAXI:30 Ncm

Interfase de titanio rotatoria para zirconio

CE Compliance according to Regulation 0051 (EU) 2017/745 verified by Notified Body

[Rot]

ALTURA (H)	MINI	STD	MAXI
0,5 mm	23237805	23207805	23257805
1 mm	23237810	23207810	23257810
2 mm	23237820	23207820	23257820
3 mm	23237830	23207830	23257830



Ticare recomienda la utilización de pilares cónicos para múltiples

INTERFASE DE TIT. ROT ZIRCONIO

- Material Titanio grado V
- Altura gingival (H) desde 0,5 hasta 3 mm. L= 4
- Ø:3,7 (Mini); 4,5 (Std y Maxi)
- Destornillador hexagonal de 1,25 mm
- Para realizar restauraciones personalizadas en zirconio y otros materiales
- Para restauraciones múltiples
- Toma de impresión: Consulte scanbodies pág. 25
- Librerías disponibles para ExoCad®, 3Shape® y Dentalwings®
- Incluye el tornillo de pilar: MINI Ref: 23232526; STD Ref:23202526 y MAXI Ref: 23205025

Recomendaciones:
- Torque MINI: 20 Ncm
- Torque STD Y MAXI:30 Ncm

Interfase dinámica rotatoria para zirconio

CE Compliance according to Regulation 0051 (EU) 2017/745 verified by Notified Body

[Rot]

ALTURA (H)	MINI	STD	MAXI
0,5 mm	23237605	23207605	23257605
1 mm	23237610	23207610	23257610
2 mm	23237620	23207620	23257620
3 mm	23237630	23207630	23257630



Ticare recomienda la utilización de pilares cónicos para múltiples

INTERFASE DIN. ROT. PARA ZIRCONIO

- Material Titanio grado V
- Altura gingival (H) desde 0,5 hasta 3 mm. L= 4
- Ø:3,7 (Mini); 4,5 (Std y Maxi)
- Destornillador dinámico
- Para realizar restauraciones personalizadas en zirconio y otros materiales
- Para restauraciones múltiples
- Toma de impresión: Consulte scanbodies pág. 25
- Librerías disponibles para ExoCad®, 3Shape® y Dentalwings®
- Incluye el tornillo de interfase. Ver tabla página 60

Recomendaciones:
- Torque MINI: 20 Ncm
- Torque STD Y MAXI:30 Ncm

ticare
inHEX
PRÓTESIS



Interfase de titanio hexagonal para zirconio TCP

CE Compliance according to Regulation 0051 (EU) 2017/745 verified by Notified Body

[Hex] ALTURA (H)	MINI	STD	MAXI
2 mm	23637920	23607920	23657920
3 mm	23637930	23607930	23657930
4 mm	-	23607940	23657940



INTERFASE TIT. HEX PARA ZIRCONIO TCP

- Material: Titanio grado V
- Emergencia TCP
- Destornillador: 1,25 mm hexagonal
- Toma de impresión: Consulte scanbodies pág. 25
- Librerías disponibles para ExoCad®, 3Shape® y Dentalwings®

MINI

- Plataforma: 2,30 mm
- Ø 3,7 mm L=4
- Incluye tornillo Ref: 23632526
- Torque: 20 Ncm

STD

- Plataforma: 2,80 mm
- Ø 4,5 mm L=4
- Incluye tornillo H2 Ref: 23602516 H3-4 Ref: 23602526
- Torque: 30 Ncm

MAXI

- Plataforma: 3,80 mm
- Ø 4,5 mm L=4
- Incluye tornillo Ref: 23205025
- Torque: 30 Ncm

Recomendaciones:

- Usado como interfase para rehabilitaciones en zirconio y otros materiales
- Para restauraciones unitarias

Interfase dinámica hexagonal para zirconio TCP

CE Compliance according to Regulation 0051 (EU) 2017/745 verified by Notified Body

[Hex] ALTURA (H)	MINI	STD	MAXI
2 mm	23637720	23607720	23657720
3 mm	23637730	23607730	23657730
4 mm	-	23607740	23657740



INTERF. DIN. TIT. HEX. ZIRCONIO TCP

- Material: Titanio grado V
- Emergencia TCP
- Destornillador dinámico
- Toma de impresión: Consulte scanbodies pág. 25
- Librerías disponibles para ExoCad®, 3Shape® y Dentalwings®

MINI

- Plataforma: 2,30 mm
- Ø 3,7 mm L=4 mm
- Incluye tornillo de interfase. Ref: 44301490
- Torque: 20 Ncm

STD

- Plataforma: 2,80 mm
- Ø 4,5 mm L=4 mm
- Incluye tornillo de interfase. H2 Ref: 44301679, H3-4 Ref: 44301698
- Torque: 30 Ncm

MAXI

- Plataforma: 3,80 mm
- Ø 4,5 mm L=4 mm
- Incluye tornillo de interfase. H2 Ref: 44302098, H3-4 Ref: 44302018
- Torque: 30 Ncm

Recomendaciones:

- Usado como interfase para rehabilitaciones en zirconio y otros materiales
- Para restauraciones unitarias




Interfase de titanio rotatoria para zirconio TCP

CE 0051 Compliance according to Regulation (EU) 2017/745 verified by Notified Body

[Ror]

ALTURA (H)	MINI	STD	MAXI
2 mm	23637820	23607820	23657820
3 mm	23637830	23607830	23657830
4 mm		23607840	23657840

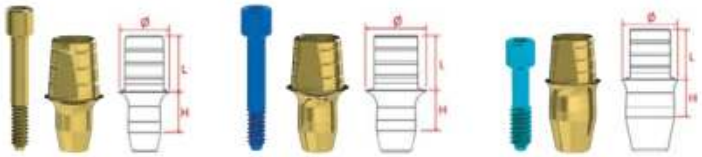


Ticare recomienda la utilización de pilares cónicos para múltiples

Interfase dinámica rotatoria para zirconio TCP

CE 0051 Compliance according to Regulation (EU) 2017/745 verified by Notified Body

[Rot]

ALTURA (H)	MINI	STD	MAXI
2 mm	23637620	23607620	23657620
3 mm	23637630	23607630	23657630
4 mm	-	23607640	23657640

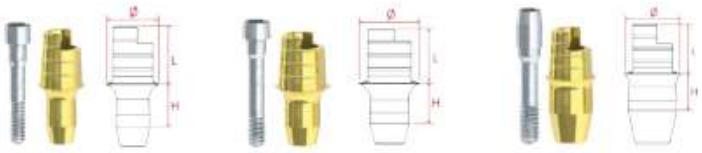

Ticare recomienda la utilización de pilares cónicos para múltiples

INTERFASE DE TIT. ROT ZIRCONIO TCP

- Material: Titanio grado V
- Emergencia TCP
- Destornillador: 1,25 mm hexagonal
- Toma de impresión: Consulte scanbodies pág. 25
- Librerías disponibles para ExoCad®, 3Shape® y Dentalwings®

MINI

- Plataforma: 2,30 mm
- Ø 3,7 mm L=4
- Incluye tornillo Ref: 23632526
- Torque: 20 Ncm

STD

- Plataforma: 2,80 mm
- Ø 4,5 mm L=4
- Incluye tornillo H2 Ref: 23602516, H3-4 Ref: 23602526
- Torque: 30 Ncm

MAXI

- Plataforma: 3,80 mm
- Ø 4,5 mm L=4
- Incluye tornillo Ref: 23205025
- Torque: 30 Ncm

Recomendaciones:

- Usado como interfase para rehabilitaciones en zirconio y otros materiales
- Para atornillar
- Para restauraciones múltiples

INTERFASE DIN. TIT. ROT ZIRCONIO TCP

- Material: Titanio grado V
- Emergencia TCP
- Destornillador dinámico
- Toma de impresión: Consulte scanbodies pág. 25
- Librerías disponibles para ExoCad®, 3Shape® y Dentalwings®

MINI

- Plataforma: 2,30 mm
- Ø 3,7 mm L=4 mm
- Incluye tornillo de interfase. Ref: 44301490
- Torque: 20 Ncm

STD

- Plataforma: 2,80 mm
- Ø 4,5 mm L=4mm
- Incluye tornillo de interfase. H2 Ref: 44301679, H3-4 Ref: 44301698
- Torque: 30 Ncm

MAXI

- Plataforma: 3,80 mm
- Ø 4,5 mm L=4 mm
- Incluye tornillo de interfase. H2 Ref: 44302098, H3-4 Ref: 44302018
- Torque: 30 Ncm

Recomendaciones:

- Usado como interfase para rehabilitaciones en zirconio y otros materiales
- Para atornillar
- Para restauraciones múltiples

ticare

inHEX PRÓTESIS




Pilar fijo hexagonal

CE 0051 Compliance according to Regulation (EU) 2017/745 verified by Notified Body

ALTURA (H)	MINI	STD	MAXI
0.5 mm	-	23207000	23207050
1 mm	23207031	23207010	23207051
2 mm	23207032	23207012	23207052
3 mm	23207033	23207013	23207053
4 mm	-	23207014	23207054

[Hex]

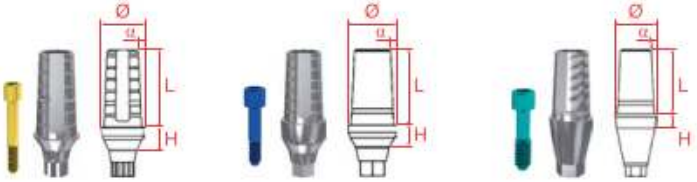

PILAR FIJO HEXAGONAL

- Material Titanio grado V
- Para restauraciones unitarias y múltiples cementadas
- Para restauraciones de zirconio
- Toma de impresión: Consulte scanbodies pág. 25
- Librerías disponibles para ExoCad®, 3Shape® y Dentalwings®
- Toma de impresión directa a implante
- Destornillador hexagonal de 1,25 mm
- Incluye el tornillo de pilar: MINI Ref:23232526; STD Ref: 23202526 y MAXI Ref: 23205025

MINI:
- Plataforma: 2,3 mm
- Ø: 3,7 mm
- α= 2°
- L: 6,5 mm

STD:
- Plataforma: 2,8 mm
- Ø: 4,5 mm
- α= 2°
- L: 6,5 mm

MAXI:
- Plataforma: 3,8 mm
- Ø: 4,5 mm
- α= 2°
- L: 6,5 mm

Recomendaciones:
- La altura de la encía debe ser ligeramente superior a la altura del hombro del pilar
- Torque MINI: 20 Ncm
- Torque STD/MAXI: 30 Ncm

Pilar fijo hexagonal TCP

CE 0051 Compliance according to Regulation (EU) 2017/745 verified by Notified Body

ALTURA (H)	MINI	STD	MAXI
2 mm	23607032	23607012	23607052
3 mm	23607033	23607013	23607053
4 mm	-	23607014	23607054

[Hex]



PILAR FIJO HEXAGONAL TCP

- Material: Titanio grado V
- Emergencia TCP
- Destornillador: 1,25 mm hexagonal
- Toma de impresión: Consulte scanbodies pág. 25
- Librerías disponibles para ExoCad®, 3Shape® y Dentalwings®

MINI
- Plataforma: 2,30 mm
- Ø 3,7 mm L=6,5
- Incluye tornillo Ref: 23632526
- Torque: 20 Ncm

STD
- Plataforma: 2,80 mm
- Ø 4,5 mm L=6,5
- Incluye tornillo H2 Ref: 23602516, H3-4 Ref: 23602526
- Torque: 30 Ncm

MAXI
- Plataforma: 3,80 mm
- Ø 4,5 mm L=6,5
- Incluye tornillo Ref: 23205025
- Torque: 30 Ncm

Recomendaciones:
- Usado como interfase para rehabilitaciones en zirconio y otros materiales
- Para restauraciones unitarias




Pilar fijo hexagonal Ø 5 mm

CE 0051 Compliance according to Regulation (EU) 2017/745 verified by Notified Body

[Hex]

ALTURA (H)	MINI	STD	MAXI
3 mm	-	23207613	23257613
4 mm	-	23207614	23257614

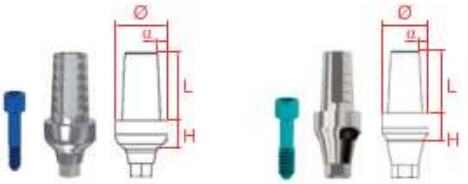

PILAR FIJO HEXAGONAL Ø 5 MM

- Material Titanio grado V
- Para restauraciones unitarias y múltiples cementadas
- Toma de impresión directa a implante
- Destornillador hexagonal de 1,25 mm
- Incluye el tornillo de pilar: STD Ref: 23202526 y MAXI Ref: 23205025

STD:
- Plataforma: 2,8 mm
- Ø: 5,0 mm
- L: 6,5 mm

MAXI:
- Plataforma 3,8 mm
- Ø: 5,0 mm
- L: 6,5 mm


Recomendaciones:
- La altura de la encía debe ser ligeramente superior a la altura del hombro del pilar
- Torque STD/MAXI: 30 Ncm

Pilar fijo hexagonal estético

CE 0051 Compliance according to Regulation (EU) 2017/745 verified by Notified Body

[Hex]

ALTURA (H)	MINI	STD	MAXI
3 mm	-	23207513	23257513
4 mm	-	23207514	23257514

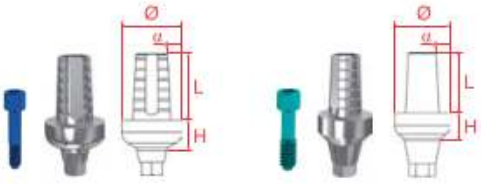

PILAR FIJO HEXAGONAL ESTÉTICO

- Material: Titanio grado V
- Para restauraciones unitarias y múltiples cementadas
- Toma de impresión a nivel de implante
- Destornillador hexagonal de 1,25 mm
- Incluye el tornillo de pilar: STD Ref: 23202526; MAXI Ref: 23205025

STD:
- Plataforma: 2,8 mm
- Ø: 6,0 mm
- L: 6,5 mm

MAXI:
- Plataforma: 3,8 mm
- Ø: 6,0 mm
- L: 6,5 mm

Recomendaciones:
- La altura de la encía debe ser ligeramente superior a la altura del hombro del pilar
- Torque STD/MAXI: 30 Ncm



Pilar angulado

CE Compliance according to Regulation 0051 (EU) 2017/745 verified by Notified Body

ANGULACIÓN (α)	ALTURA (H)	MINI	STD	MAXI
15°	1 mm	23231015	23201015	23251015
	3 mm	-	23201315	23251315
	5 mm	-	23201515	23251515
20°	1 mm	23231020	23201020	23251020
	3 mm	-	23201320	23251320
	5 mm	-	23201520	23251520

[Hex]



PILAR ANGULADO

- Material: Titanio grado V
- para restauraciones unitarias y múltiples cementadas
- Toma de impresión a nivel de implante
- Para corregir disparalelismos e implantes con ejes axiales incorrectos
- Destornillador hexagonal de 1,25 mm
- Incluye el tornillo de pilar:
  MINI Ref: 232310151
  STD Ref: 232010151 (H=1)
  Ref: 23202526 (H=3, H=5)
  MAXI Ref: 232510151

MINI:
- Plataforma: 2,3 mm
- Ø: 3,7 mm
- L: 6,5 mm

STD:
- Plataforma: 2,8 mm
- Ø: 4,0 mm
- L: 6,5 mm

MAXI:
- Plataforma: 3,8 mm
- Ø: 4,0 mm
- L: 6,5 mm

Recomendaciones:
- La altura de la encía debe ser ligeramente superior a la altura del hombro del pilar
- Torque MINI: 20 Ncm
- Torque STD/MAXI: 30 Ncm

Pilar angulado Ø 5 mm

CE Compliance according to Regulation 0051 (EU) 2017/745 verified by Notified Body

ANGULACIÓN (α)	ALTURA (H)	MINI	STD	MAXI
15°	1 mm	-	23206015	23256015
	3 mm	-	23206315	23256315
	5 mm	-	23206515	23256515
20°	1 mm	-	23206020	23256020
	3 mm	-	23206320	23256320
	5 mm	-	23206520	23256520

[Hex]



PILAR ANGULADO Ø 5 MM

- Material: Titanio grado V
- Para restauraciones unitarias y múltiples cementadas
- Toma de impresión a nivel de implante
- Para corregir disparalelismos e implantes con ejes axiales incorrectos
- Destornillador hexagonal de 1,25 mm
- Incluye el tornillo de pilar
  STD Ref: 232010151 (H=1)
  Ref: 23202526 (H=3, H=5)
  MAXI Ref: 232510151

STD:
- Plataforma: 2,8 mm
- Ø: 5,0 mm
- L: 6,5 mm

MAXI:
- Plataforma 3,8 mm
- Ø: 5,0 mm
- L: 6,5 mm

Recomendaciones:
- La altura de la encía debe ser ligeramente superior a la altura del hombro del pilar
- Torque STD/MAXI: 30 Ncm



ticare
inHEX
PRÓTESIS


Sistema de Prótesis Inhex con transepitelial

Pilar cónico

CE Compliance according to Regulation 0051 (EU) 2017/745 verified by Notified Body

[No Hex]

ANGULACIÓN (α)	ALTURA (H)	MINI	STD	MAXI
10°	0 mm	-	23201000	23201050
	1 mm	23201031	23201001	23201051
	2 mm	23201032	23201002	23201052
	3 mm	23201033	23201003	23201053
	4 mm	-	23201004	23201054
	5 mm	-	23201005	23201055
30°	1 mm	-	23203001	23253001
	2 mm	-	23203002	23253002
	3 mm	-	23203003	23253003
	4 mm	-	23203004	23253004
	5 mm	-	23203005	23253005

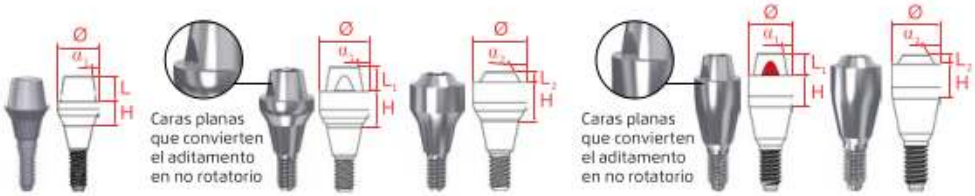


MINI STD MAXI

Pilar cónico TCP

CE Compliance according to Regulation 0051 (EU) 2017/745 verified by Notified Body

[No Hex]

ANGULACIÓN (α)	ALTURA (H)	MINI	STD	MAXI
10°	2 mm	23601032	23601002	23601052
	3 mm	23601033	23601003	23601053
	4 mm	-	23601004	23601054
	5 mm	-	23601005	23601055
30°	2 mm	-	23603002	23653002
	3 mm	-	23603003	23653003
	4 mm	-	23603004	23653004
	5 mm	-	23603005	23653005

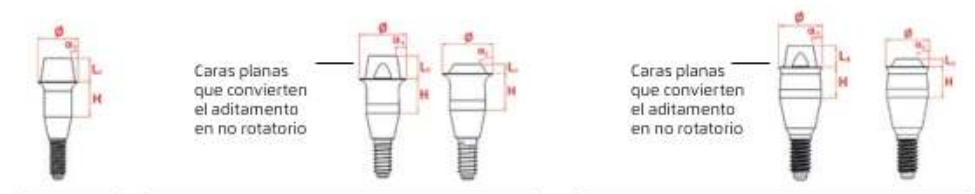

MINI STD MAXI

PILAR CÓNICO

- Material Titanio grado V
- Para restauraciones atornilladas múltiples
- Para sobredentaduras sobre barras
- Toma de impresión a nivel de pilar
- El cono superior de 10° y 30° permite la inserción protésica pasiva en rehabilitaciones entre implantes con disparalelismos de hasta 20° y 60° respectivamente.
- Destornillador hexagonal de 1,25 mm

MINI:
- Plataforma: 2,3 mm
- Ø: 3,4 mm
- L: 2 mm

STD:
- Plataforma: 2,8 mm
- Ø: 4 mm
- L_1: 2 mm; L_2: 0,75 mm

MAXI:
- Plataforma 3,8 mm
- Ø: 4 mm
- L_1: 2 mm; L_2: 0,75 mm

Recomendaciones:
- Pilar cónico 10° STD y MAXI para restauraciones unitarias
- Pilar cónico 10° MINI y pilar cónico 30° STD y MAXI para restauraciones múltiples
- Torque MINI: 20 Ncm
- Torque STD/MAXI: 30 Ncm

PILAR CÓNICO TCP

- Material: Titanio Grado V
- Emergencia TCP
- Destornillador: 1,25 mm hexagonal

MINI:
- Plataforma: 2,3 mm
- Ø: 3,4 mm
- L_1: 2 mm L_2: 0.75 mm

STD:
- Plataforma: 2,8 mm
- Ø: 4 mm
- L_1: 2 mm; L_2: 0,75 mm

MAXI:
- Plataforma 3,8 mm
- Ø: 4 mm
- L_1: 2 mm; L_2: 0,75 mm

Recomendaciones:
- Pilar cónico 10° STD y MAXI para restauraciones unitarias.
- Pilar cónico 10° MINI y pilar cónico 30° STD y MAXI para restauraciones múltiples
- Para atornillar
- Sus angulaciones de 10° y de 30° le ayudan a corregir disparalelismos entre implantes hasta 20° y 60°.
- Torque MINI: 20 Ncm
- Torque STD y MAXI: 30 Ncm

ticare

inHEX PRÓTESIS


Sistema de Prótesis Inhex con transepitelial



Interfase de titanio para zirconio pilar cónico

CE 0051 Compliance according to Regulation (EU) 2017/745 verified by Notified Body

ANGULACIÓN (α)	DESCRIPCIÓN	MINI	STD / MAXI
10°	Rotatorio	13237902	13207902
	No rotatorio	-	13207952
30°	Rotatorio	-	13207953
	No rotatorio	-	-



Interfase dinámica para zirconio pilar cónico

CE 0051 Compliance according to Regulation (EU) 2017/745 verified by Notified Body


ANGULACIÓN (α)	DESCRIPCIÓN	MINI	STD / MAXI
10°	Rotatorio	13237602	13207602
	No rotatorio	-	13207652
30°	Rotatorio	-	13207653
	No rotatorio	-	-



Pilar titanio pilar cónico

CE 0051 Compliance according to Regulation (EU) 2017/745 verified by Notified Body

ANGULACIÓN (α)	DESCRIPCIÓN	MINI	STD/MAXI
10°	Rotatorio	13209233	13209251
	No rotatorio	-	13209252
30°	Rotatorio	-	13209253
	No rotatorio	-	-





MINI STD/MAXI

INTERFASE DE TITANIO PILAR CÓNICO

- Material Titanio grado V
- Para estructuras personalizadas en zirconio sobre pilares cónicos
- Para restauraciones múltiples atornilladas
- Toma de impresión a nivel de pilar
- Librerías disponibles para ExoCad®, 3Shape® y Dentalwings®
- Destornillador hexagonal de 1,25 mm
- Consultar scanbodies en pág. 24

MINI:
- Ø: 3,4 mm L: 5,5 mm H: 0,85 mm
- Incluye el tornillo para prótesis Ref. 13202528

STD/MAXI:
- Ø: 4,1 mm L: 5,05 mm H: 0,40 mm
- Incluye el tornillo para prótesis Ref. 13202528

Recomendaciones:
- MINI: Torque 15 Ncm
- STD/MAXI: Torque 20 Ncm

INTERFASE DINÁMICA PILAR CÓNICO

- Material Titanio grado V
- Para estructuras personalizadas en zirconio sobre pilares cónicos
- Para restauraciones múltiples atornilladas
- Toma de impresión a nivel de pilar
- Librerías disponibles para ExoCad®, 3Shape® y Dentalwings®
- Destornillador dinámico
- Consultar scanbodies en pág. 24

MINI:
- Ø: 3,4 mm L: 5,5 mm H: 0,85 mm
- Incluye el tornillo para prótesis (Ref. 44302041)

STD/MAXI:
- Ø: 4,1 mm L: 5,05 mm H: 0,40 mm
- Incluye el tornillo para prótesis (Ref. 44302041)

Recomendaciones:
- MINI: Torque 15 Ncm
- STD/MAXI: Torque 20 Ncm

PILAR TITANIO PILAR CÓNICO

- Material Titanio grado V
- Librerías disponibles para ExoCad®, 3Shape® y Dentalwings®
- Altura de cementación 10mm con pre-cortes a 8 y 6 mm
- Destornillador hexagonal de 1,25 mm
- Consultar scanbodies en pág. 24

MINI:
- Ø: 3,4 mm H:1 mm L: 11 mm
- Incluye el tornillo para prótesis Ref. 13202528

STD/MAXI:
- Ø: 4 mm H: 1 mm L: 11 mm
- Incluye el tornillo para prótesis Ref. 13202528

Recomendaciones:
- Los no rotatorios se presentan en color púrpura para una fácil identificación
- Torque MINI: 15 Ncm
- Torque STD/MAXI: 20 Ncm




Sistema de Prótesis Inhex con transepitelial

Cilindro calcinable pilar cónico

CE Compliance according to Regulation (EU) 2017/745

ANGULACIÓN (α)	DESCRIPCIÓN	MINI	STD/MAXI
10°	Rotatorio	13209133	13209151
	No rotatorio	-	13209152
30°	Rotatorio	-	13209153
	No rotatorio	-	-



CILINDRO CALCINABLE PILAR CÓNICO

- Material: Plástico calcinable
- Destornillador hexagonal de 1,25 mm

MINI:
- Ø: 3,4 mm H:1 mm L: 11 mm
- Incluye el tornillo para prótesis Ref: 13202528

STD/MAXI:
- Ø: 4 mm H: 1 mm L: 11 mm
- Incluye el tornillo para prótesis Ref: 13202528

Recomendaciones:
- Los calcinables no rotatorios se presentan en color rojo para una fácil identificación
- Torque MINI: 15 Ncm
- Torque STD/MAXI: 20 Ncm

Tornillo de cicatrización pilar cónico

CE 0051 Compliance according to Regulation (EU) 2017/745 verified by Notified Body

ANGULACIÓN (α)	MINI	STD/MAXI
10°	13203310	13201000 (baja) 13201010 (alta)
30°		13201300 (baja) 13201310 (alta)



MINI 10°



STD/MAXI 10°



STD/MAXI 30°

TORN. CICATRIZACION PILAR CÓNICO

- Material Titanio grado V
- Destornillador hexagonal de 1,25 mm

10° MINI:
- Ø: 3,4 mm
- L: 4.40 mm
- La Ref: 13203310 incluye tornillo

10° STD y MAXI:
- Ø: 4 mm
- L: 3,70 mm (baja) L: 4,40 mm (alta)

30° STD Y MAXI:
- Ø: 4 m
- L: 2,45 mm (baja) L: 4,40 mm (alta)

Recomendaciones:
- Torque: 10 Ncm

ticare
inHEX PRÓTESIS

Sistema de Prótesis Inhex con transepitelial



Postes de impresión pilar cónico cubeta abierta CE

Compliance according to Regulation (EU) 2017/745

ANGULACIÓN (α)		MINI	STD/MAXI
10°	[rot]	13203313	13205513
	[No rot]		13205213
30°	[rot]	-	13205530



10° MINI



10° STD/MAXI ROT



10° STD/MAXI NO ROT



30° STD/MAXI

Postes de impresión pilar cónico cubeta cerrada CE

Compliance according to Regulation (EU) 2017/745

ANGULACIÓN (α)		MINI	STD/MAXI
10°	[rot]	-	13205613
30°	[rot]	-	13205630



Análogo pilar cónico CE

Compliance according to Regulation (EU) 2017/745

ANGULACIÓN (α)		MINI	STD/MAXI
10°	Análogo	13205551	13205511
	Análogo digital	41005541	41005511
30°	Análogo	-	13203511
	Análogo digital	-	41003511



POSTES IMPRESIÓN CUB ABIERTA

- Material Acero inoxidable

MINI:
- Ø: 3,4 mm L: 11 mm H: 3 mm

STD/MAXI:
- Ø: 4 mm L: 11 mm H: 3 mm

- Poste pilar cónico 10° MINI y STD/MAXI incluye el tornillo de poste de impresión Ref: 132055331
- Poste pilar cónico 30° STD/MAXI incluye el tornillo de poste de impresión Ref: 132055302
- El poste de impresión no rotatorio se presenta en color púrpura
- Tornillo poste impresión largo pilar cónico 10° mini/std/maxi Ref: 132055332
- Tornillo poste impresión largo pilar cónico 30° Ref: 132055301

POSTES IMPRESIÓN CUB CERRADA

- Material Acero inoxidable
- L: 8,5 mm

STD/MAXI:
- Ø: 4,1 mm L: 8,5 mm H: 2,8 mm

- Los postes de impresión de cubeta cerrada son de una sola pieza.

ANÁLOGO PILAR CÓNICO

- Material Acero inoxidable

Análogo para modelo de escayola:
- Diseño en una pieza, altamente retentivo.
- Un sólo uso.

Análogo digital:
- Diseño en dos piezas roscadas y amplia superficie de posicionamiento axial, radial y angular para una fácil y precisa colocación en el modelo 3D.
- Una vez finalizado el trabajo se pueden desmontar y reutilizar en otro modelo siempre que no haya sufrido daños.



ticare
inHEX
PRÓTESIS

Pilares Multiunit

Pilar Multiunit recto

CE 0051 Compliance according to Regulation (EU) 2017/745 verified by Notified Body

ALTURA (H)	MINI	STD	MAXI
1 mm	-	23209901	23259901
2 mm	-	23209902	23259902
3 mm	-	23209903	23259903
4 mm	-	23209904	23259904
5 mm		23209905	23259905



Transportador manual incluido para posicionar en boca



Pilar Multiunit recto TCP

CE 0051 Compliance according to Regulation (EU) 2017/745 verified by Notified Body

ALTURA (H)	MINI	STD	MAXI
2 mm	-	23609902	23659902
3 mm	-	23609903	23659903
4 mm	-	23609904	23659904
5 mm	-	23609905	23659905



Transportador manual incluido para posicionar en boca



Pilar Multiunit angulado

CE 0051 Compliance according to Regulation (EU) 2017/745 verified by Notified Body

ANGULACIÓN (α)	ALTURA (H)	MINI	STD	MAXI
17°	2 mm	-	23201720	23251720
	3 mm	-	23201730	23251730
	4 mm	-	23201740	23251740
30°	3 mm	-	23203030	23253030
	4 mm	-	23203040	23253040
	5 mm	-	23203050	23253050

[Hex]



Incluye vástago de posicionamiento para facilitar la inserción



PILAR MULTIUNIT RECTO

- Material Titanio grado V
- Para estructuras atornilladas sobre pilares
- Toma de impresión a nivel de pilar
- El cono superior de 20° permite la inserción protésica pasiva en rehabilitaciones entre implantes con disparalelismos de hasta 40°.
- Para atornillar utilizar llave dinamométrica Ref: 14658040 y extensor de carraca Ref: 14658009 (Corto) y 14658016 (Largo). También se puede atornillar con contra-ángulo Ref: 23209021.

STD:
- Plataforma: 2,8 mm
- Ø: 4,8 mm L_1: 2,2 mm; α_1=20°

MAXI:
- Plataforma 3,8 mm
- Ø: 4,8 mm L_1: 2,2 mm; α_1=20°

Recomendaciones:
- Torque STD/MAXI: 30 Ncm

PILAR MULTIUNIT TCP

- Material: Titanio grado V
- Emergencia TCP
- Para estructuras atornilladas sobre pilares
- Toma de impresión a nivel de pilar
- El cono superior de 20° permite la inserción protésica pasiva en rehabilitaciones entre implantes con disparalelismos de hasta 40°
- Para atornillar utilizar llave dinamométrica Ref: 14658040 y extensor de carraca Ref: 14658009 (Corto) y 14658016 (Largo). También se puede atornillar con contra-ángulo Ref: 23209021.

STD:
- Plataforma: 2,8 mm
- Ø: 4,8 mm L_1: 2,2 mm; α_1=20°

MAXI:
- Plataforma 3,8 mm
- Ø: 4,8 mm L_1: 2,2 mm; α_1=20°

Recomendaciones:
- Torque STD/MAXI: 30 Ncm

PILAR MULTIUNIT ANGULADO

- Material Titanio grado V
- Para restauraciones múltiples atornilladas
- Toma de impresión a nivel de pilar
- Para corregir grandes disparalelismos entre implantes
- Pilares de 17°: α_1= 20° α_2= 17°
- Pilares de 30°: α_1=20° α_2=30°
- Destornillador hexagonal de 1,25 mm
- Incluye el tornillo de multiunit angulado (STD Ref. 23201726; MAXI Ref. 23251726)
- Incluye vástago de posicionamiento

Recomendaciones:
- Torque STD/MAXI: 30 Ncm

ticare

inHEX PRÓTESIS

Pilares Multiunit




Tornillo cicatrización pilar Multiunit

CE Compliance according to Regulation 0051 (EU) 2017/745 verified by Notified Body

STD / MAXI

17°/20°/30° Compatible multiunit recto y angulado	13201017	(baja)
	13201027	(alta)



TORNILLO CICATRIZACIÓN PILAR MULTIUNIT

- Material Titanio grado V
- Ø: 4,8 mm
- L: 3,95 mm (baja) L: 4,70 mm (alta)
- Destornillador hexagonal de 1,25 mm

Recomendaciones:
- Torque: 10 Ncm

Poste impresión pilar Multiunit cubeta abierta

CE Compliance according to Regulation (EU) 2017/745

STD / MAXI

Rotatorio

17°/20°/30° Compatible multiunit recto y angulado	13205217



POSTE IMPRESIÓN P. MULTIUNIT

- Material Acero inoxidable
- Ø: 4,8 mm
- L: 11 mm
- H: 3,5 mm
- Incluye el tornillo de poste de impresión Ref: 132055371

Recomendaciones:
- Torque: 10 Ncm

Poste impresión pilar Multiunit cubeta cerrada

CE Compliance according to Regulation (EU) 2017/745

STD / MAXI

Rotatorio

17°/20°/30° Compatible multiunit recto y angulado	13205617



POSTE IMPRESIÓN P. MULTIUNIT

- Material Acero inoxidable
- Ø: 4,8 mm
- L: 8,5 mm
- H: 2,8 mm
- Los postes de impresión de cubeta cerrada son de una sola pieza

Recomendaciones:
- Torque: 10 Ncm

Análogo pilar Multiunit

CE Compliance according to Regulation (EU) 2017/745

STD / MAXI

Rotatorio

17°/20°/30° Compatible multiunit recto y angulado	Análogo	13205117
	Análogo digital	41145117



ANÁLOGO PILAR MULTIUNIT

- Material: Acero inoxidable
- Ø: 4,8 mm

Análogo para modelos de escayola:
- Diseño de una pieza, altamente retentivo.
- Un solo uso.

Análogo para flujo digital:
- Diseño en dos piezas roscadas y amplia superficie de posicionamiento para una fácil y precisa colocación. Una vez finalizado el trabajo se pueden desmontar y reutilizar en otro modelo siempre que no haya sufrido daños.

Interfase de titanio para zirconio pilar Multiunit

CE Compliance according to Regulation 0051 (EU) 2017/745 verified by Notified Body

STD / MAXI

Rotatorio

17°/20°/30° Compatible multiunit recto y angulado	13207917



INTERFASE DE TITANIO PILAR MULTIUNIT

- Material Titanio grado V
- Para realizar estructuras personalizadas en zirconio sobre pilares multiunit rectos o angulados
- Para restauraciones múltiples atornilladas.
- Toma de impresión a nivel de pilar
- Librerías disponibles para ExoCad®, 3Shape® y Dentalwings®
- Ø: 4,8 mm L: 5,5 mm H: 0,85 mm
- Destornillador hexagonal de 1,25 mm
- Incluye el tornillo para prótesis Ref: 13201727

Recomendaciones:
- Torque: 15 Ncm



Interfase dinámica para zirconio pilar Multiunit

CE Compliance according to Regulation 0051 (EU) 2017/745 verified by Notified Body

Rotatorio

STD / MAXI

17°/20°/30°
Compatible
multiunit recto y
angulado

13207617



INTERFASE DINÁMICAPILAR MULTIUNIT

- Material Titanio grado V
- Para realizar estructuras personalizadas en zirconio sobre pilares multiunit rectos o angulados
- Para restauraciones múltiples atornilladas.
- Toma de impresión a nivel de pilar
- Librerías disponibles para ExoCad®, 3Shape® y Dentalwings®
- Ø: 4,8 mm L: 5,5 mm H: 0,85 mm
- Destornillador dinámico
- Incluye el tornillo de interfase. Ref: 44301440

Recomendaciones:
- Torque: 15 Ncm

Cilindro titanio pilar Multiunit


CE Compliance according to Regulation 0051 (EU) 2017/745 verified by Notified Body

Rotatorio

STD / MAXI

17°/20°/30°
Compatible
multiunit recto y
angulado

13209117

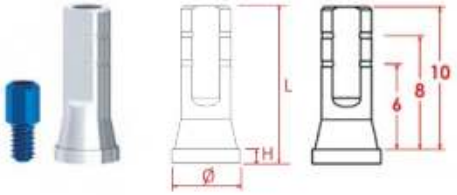

CILINDRO DE TITANIO PILAR MULTIUNIT

- Material Titanio grado V
  Ø: 4,8 mm L: 11 mm H: 1 mm
- Librerías disponibles para ExoCad®, 3Shape® y Dentalwings®
- Altura de cementación 10mm con pre-cortes a 8 y 6 mm
- Destornillador hexagonal de 1,25 mm
- Consultar scanbodies en pág. 24
- Incluye tornillo para prótesis Ref: 13201727

Recomendaciones:
- Torque: 15 Ncm

Cilindro calcinable pilar Multiunit


CE Compliance according to Regulation (EU) 2017/745

Rotatorio

STD / MAXI

17°/20°/30°
Compatible
multiunit recto y
angulado

13201751



CILINDRO CALCINABLE PILAR MULTIUNIT

- Material: Plástico calcinable
- Destornillador hexagonal de 1,25 mm
- Incluye tornillo para prótesis Ref: 13201727
- Ø: 4,8 mm L: 11 mm H: 1 mm

Recomendaciones:
- Torque: 15 Ncm

ticare

inHEX PRÓTESIS

Sistema de Prótesis Inhex temporal



Pilar fijo altura 2 mm tallable

CE Compliance according to Regulation 0051 (EU) 2017/745 verified by Notified Body

	MINI	STD	MAXI
[Hex]	23232110	23202110	23252110
[No Hex]	-	23203110	23253110



Plastic cap: Solo para STD y MAXI
Facilita y asegura un correcto ajuste de la prótesis temporal



PILAR FIJO ALTURA 2 MM TALLABLE

- Material: Titanio grado V
- Para restauraciones temporales cementadas y atornilladas unitarias y restauraciones cementadas múltiples
- Superficie retentiva para una fácil adhesión del provisional
- Incluye un plastic cap (STD y MAXI) para una fabricación sencilla y una correcta adaptación de la corona provisional
- Toma de impresión a nivel de implante
- Destornillador hexagonal de 1,25 mm
- Incluye el tornillo de retención: MINI Ref. 23232526: STD Ref: 23202526 y MAXI Ref: 23205025

MINI:
- Ø: 3,7 mm L: 6,5 mm H: 2 mm

STD/MAXI:
- Ø: 4,5 mm L: 6,5 mm H: 2 mm
- L: plastic cap: 7,6 mm

Recomendaciones:
- Para permanecer 2 ó 3 meses en boca
- Torque: 10 Ncm

Pilar ucla titanio temporal

CE Compliance according to Regulation 0051 (EU) 2017/745 verified by Notified Body

	MINI	STD	MAXI
[Hex]	-	23204110	23254110
[No Hex]	-	23205110	23255110



PILAR TITANIO TEMPORAL

- Material: Titanio grado V
- Para restauraciones temporales cementadas unitarias y múltiples y atornilladas unitarias
- Para trabajar tanto en clínica como en laboratorio
- Superficie retentiva para una fácil adhesión del provisional
- Toma de impresión a nivel de implante
- Destornillador hexagonal de 1,25 mm
- Incluye el tornillo de retención: STD Ref: 23202526; y MAXI Ref: 23205025

STD:
- Ø: 4,3 mm L: 11 mm H: 3,5 mm

MAXI:
- Ø: 4,3 mm L: 11 mm H: 5 mm

Recomendaciones:
- Para permanecer 2 ó 3 meses en boca
- Torque: 10 Ncm

Pilar ucla calcinable temporal

CE Compliance according to Regulation (EU) 2017/745

	MINI	STD	MAXI
[Hex] [Rojo]	-	23208151	23208155
[No Hex] [Blanco]	-	23207151	23207155



PILAR UCLA TEMPORAL

- Material Plástico calcinable
- Para restaurar directo al implante
- Plataforma STD 2,80 mm
- Plataforma MAXI 3,80 mm
- Destornillador hexagonal de 1,25 mm

STD:
- Ø: 4,3 mm L: 11 mm H: 3,5 mm

MAXI:
- Ø: 4,3 mm L: 11 mm H: 5 mm

Recomendaciones:
- En restauraciones unitarias se recomienda utilizar hexagonal
- Para restauraciones provisionales, válido para 2 ó 3 meses en boca
- Torque: 10 Ncm
- Incluye tornillo: STD Ref: 23202526; y MAXI Ref: 23205025



Pilar temporal de titanio para pilar cónico

CE 0051 Compliance according to Regulation (EU) 2017/745 verified by Notified Body

[Rotatorio]

	MINI	STD/MAXI
10°	13236110	13206110
30°	-	13206130



PILAR TEMPORAL DE TITANIO PARA PILAR CÓNICO

- Material Titanio grado V
- Para restauraciones temporales atornilladas múltiples sobre pilar cónico
- Superficie retentiva para fácil adhesión del provisional
- Permite la confección de prótesis provisionales en protocolos de carga inmediata
- Destornillador hexagonal de 1,25 mm
- Incluye el tornillo para prótesis Ref: 13202528

MINI:
- Ref: 13236110: Ø: 3,4 mm L: 11 mm H: 1 mm

STD/MAXI:
- Ref: 13206110: Ø: 4,1 mm L: 11 mm H: 1 mm
- Ref: 13206130: Ø: 4,1 mm L: 11 mm H: 1 mm
- STD y MAXI aditamentos compatibles

Recomendaciones:
- Para permanecer 2 ó 3 meses en boca
- Torque: 10 Ncm

Pilar temporal calcinable para pilar cónico MINI

CE 0051 Compliance according to Regulation (EU) 2017/745 verified by Notified Body

[Rotatorio]

	MINI
10°	13235110



PILAR TEMPORAL CALCINABLE PARA PILAR CÓNICO MINI

- Material: plástico calcinable
- Para atornillar
- Destornillador hexagonal de 1,25 mm
- Superficie retentiva para fácil adesión del provisional
- Incluye el tornillo para prótesis Ref: 13202528

MINI: Ø: 3,4 mm L: 11 mm H: 1 mm

Recomendaciones:
- 2 a 3 meses en boca
- Torque: 10 Ncm

Pilar temporal de titanio para pilar Multiunit

CE 0051 Compliance according to Regulation (EU) 2017/745 verified by Notified Body

[Rotatorio]

	STD / MAXI
17°/20°/30° Compatible multiunit recto y angulado	13206710



PILAR TEMPORAL DE TITANIO PARA MULTIUNIT

- Material Titanio grado V
- Para restauraciones temporales atornilladas múltiples sobre pilar multiunit
- Superficie retentiva para fácil adhesión del provisional
- Permite la confección de prótesis provisionales en protocolos de carga inmediata
- Destornillador hexagonal de 1,25 mm
- Incluye el tornillo para prótesis Ref: 13201727

STD/MAXI:
- Ø: 3,3 mm L: 11 mm H: 1 mm

Recomendaciones:
- Para permanecer 2 ó 3 meses en boca
- Torque: 10 Ncm

Pilar temporal calcinable para pilar Multiunit

CE Compliance according to Regulation (EU) 2017/745

[Rotatorio]

	STD / MAXI
17°/20°/30° Compatible multiunit recto y angulado	13205710



PILAR TEMPORAL CALCINABLE PARA MULTIUNIT

- Material: Plástico calcinable
- Para atornillar
- Destornillador hexagonal de 1,25 mm
- Superficie retentiva para fácil adhesión del provisional
- Incluye el tornillo para prótesis Ref: 13201727

STD/MAXI:
- Ø: 3,3 mm L: 11 mm H: 1 mm

Recomendaciones:
- Para permanecer 2 ó 3 meses en boca
- Torque: 10 Ncm

ticare

inHEX PRÓTESIS

Sistema de Prótesis Inhex removible




Pilar de bola

CE Compliance according to Regulation 0051 (EU) 2017/745 verified by Notified Body

[No Hex]

ALTURA (H)	MINI	STD	MAXI
1 mm	-	23208610	23258610
2 mm	-	23208620	23258620
3 mm	-	23208630	23258630
4 mm	-	23208640	23258640
5,5 mm	-	23208650	23258655
Análogo	-	13205521	13205521
Retención	-	13208600	13208600

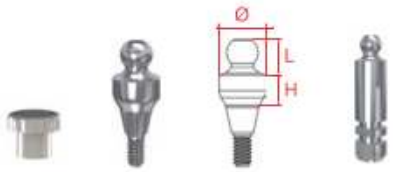

PILAR DE BOLA

- Material: Titanio grado V
- Para restauraciones implanto-retenidas
- Permiten una angulación máxima entre implantes de 10º
- Toma de impresión a nivel de implante
- Destornillador hexagonal de 1,25 mm
- Incluye retención Ref. 13208600. Material VESTAKEEP® PEEK.

STD:
- Plataforma: 2,8 mm
- Ø: 4,0 mm
- L: 3,0 mm

MAXI:
- Plataforma: 3,8 mm
- Ø: 4,0 mm
- L: 3,0 mm

Recomendaciones:
- Torque STD/MAXI 30 Ncm

Pilar Over-Loc

CE Compliance according to Regulation 0051 (EU) 2017/745 verified by Notified Body

[No Hex]

ALTURA (H)	STD	MAXI
1 mm	23209681	23259681
2 mm	23209682	23259682
3 mm	23209683	23259683
4 mm	23209684	23259684
5 mm	23209685	23259685
Pilar Over-Loc sobre barra	13209589	13209589





PILAR OVER-LOC

- Material Titanio grado V con recubrimiento de nitruro de titanio
- Para restauraciones implanto-retenidas
- Permiten una angulación máxima entre implantes de 20º, y el de rango extendido de máximo 40º.
- Toma de impresión a nivel de pilar
- Las retenciones se entregan en pack de 4 unidades
- Pilares Over-Loc: Fabricación Ticare
- Accesorios: Producto de distribución

STD:
- Plataforma: 2,8 mm
- Ø: 4,0 mm

MAXI:
- Plataforma 3,8 mm
- Ø: 4,0 mm

Recomendaciones:
- Utlizar para su colocación el Locator® Core Tool junto con el destornillador hexagonal de 1,25 mm
- Escoger la altura del pilar según la altura del margen gingival desde la plataforma del implante; así el pilar emergerá 1,5 mm por encima del margen
- Torque STD/MAXI: 30 Ncm

Accesorios

Análogo (4 uds)	19008530
Poste de impresión (4 uds)	19008505
Pack de procesado (2 uds)	19008519
Pack de procesado Locator® para barra (2 uds)	190080282
Retención transparente (fuerte)	19008524
Retención rosa (ligera)	19008527
Retención azul (extraligera)	19008529











Retenciones para implantes angulados:

Retención verde (fuerte)	19008547
Retención rojo (ligera)	19008548





ticare

inHEX PRÓTESIS

Tornillos para postes, pilares y prótesis

*CE 0051 Compliance according to Regulation (EU) 2017/745 verified by Notified Body

~CE Compliance according to Regulation (EU) 2017/745

INHEX MINI

REF.	DESCRIPCIÓN	L	A	D
~23235504	Tornillo poste impresión corto	16,4	10,45	3,4
~23235502	Tornillo poste impresión largo	22,4	17,15	2,1
~23235505	Tornillo de poste de impresión para encerado	28,3	23,05	2,1
*23232526	Tornillo retención hexagonal 1,25 mm	8,6	2	2,1
*232310151	Tornillo retención pilar angulado 15°/20°	8,2	1,6	2,1
*13202528	Tornillo para prótesis pilar cónico 10°/30°	5,05	2,2	2,4
TCP ~23635502	Tornillo poste impresión largo TCP	22,4	14,15	2,1
TCP *23632526	Tornillo retención hexagonal 1,25 mm TCP	10,6	2	2,1



TORNILLOS

- **Para tornillos Ticare BioCam puede consultar sus referencias en la pág. 27.**

Rosca métrica:
- Mini: 1,4 mm
- STD: 1,6 mm
- MAXI: 2 mm

INHEX STD

REF.	DESCRIPCIÓN	L	A	D
~23205504	Tornillo poste impresión corto	16,98	9,73	4,1
~23205502	Tornillo poste impresión largo	21,01	14,64	2,4
~23205505	Tornillo de poste de impresión para encerado	27,01	20,64	2,4
*23202526	Tornillo retención hexagonal 1,25 mm	8,4	2,3	2,4
*23202508	Tornillo retención con ranura	7,3	1,3	2,4
*232010151	Tornillo retención pilar angulado 15°/20°	7,7	1,5	2,4
*23201726	Tornillo retención pilar multiunit ang 17°/30°	7,03	1,9	2
*23282526	Tornillo retención para laboratorio (5 uds.)	8,4	2,3	2,4
*13202528	Tornillo para prótesis pilar conico 10°/30°	5,05	2,2	2,4
*13201727	Tornillo para prótesis pilar multiunit	4,55	2,45	2
*13201728	Tornillo perfil bajo para prótesis pilar multiunit	3,6	1,35	2
TCP ~23605502	Tornillo poste impresión largo TCP	21,01	11,14	2,4
TCP *23602516	Tornillo retención hexagonal 1,25 mm H2 TCP	9,4	2,3	2,4
TCP *23602526	Tornillo retención hexagonal 1,25 mm H3-H4 TCP	11,4	2,3	2,4
TCP ~23682516	Tornillo retención para laboratorio TCP H2 (5 uds)	9,4	2,3	2,4
TCP ~23682526	Tornilo retención para laboratorio TCP H3-H4 (5 uds)	11,4	2,3	2,4



INHEX MAXI

REF.	DESCRIPCIÓN	L	A	D
~23205004	Tornillo poste impresión corto	19,3	9,71	4,1
~23205002	Tornillo poste impresión largo	23,24	14,7	2,4
~23205005	Tornillo de poste de impresión para encerado	29,03	20,49	2,4
*23205025	Tornillo retención hexagonal 1,25 mm	9,7	2,3	2,4
*23202509	Tornillo retención con ranura	8,6	1,2	2,4
*13202528	Tornillo para prótesis pilar conico 10°/30°	5,05	2,2	2,4
*232510151	Tornillo retención pilar angulado 15°/20°	9,66	1,5	2,4
*23251726	Tornillo retención para multiunit ang 17°/30°	7	0,4	2,3
*13201727	Tornillo para prótesis pilar multiunit	4,55	2,45	2
*13201728	Tornillo perfil bajo para prótesis pilar multiunit	3,6	1,35	2
TCP *23285025	Tornillo retención para laboratorio (5 uds.)	9,7	2,3	2,4
TCP *23205025	Tornillo retención hexagonal 1,25 mm TCP	9,7	2,3	2,4



ticare

inHEX PRÓTESIS

Tornillos para angular interfases



INHEX MINI

CE 0051 Compliance according to Regulation (EU) 2017/745 verified by Notified Body

	REF.	DESCRIPCIÓN	M	L	D
	44301473	Tornillo para chimeneas anguladas	1,4 mm	7,3 mm	2 mm
	44301490	Tornillo para chimeneas anguladas	1,4 mm	9 mm	2 mm
TCP	44301490	Tornillo para chimeneas anguladas TCP	1,4 mm	9 mm	2 mm
	44302041	Tornillo para chimeneas ang. cónico 10º y 30º	2 mm	4,1 mm	2,3 mm



TORNILLOS ANGULAR INTERFASES

- Diseñados para poder ser insertados a través de la chimenea angulada realizada en el circonio.

- Poseen en su cabeza una conexión hexalobular para poder ser atornillados con un destornillador dinámico.

INHEX STD

CE 0051 Compliance according to Regulation (EU) 2017/745 verified by Notified Body

	REF.	DESCRIPCIÓN	M	L	D
	443010151	Tornillo para chimeneas anguladas	1,6 mm	7,2 mm	2,3 mm
	44301679	Tornillo para chimeneas anguladas H2	1,6 mm	7,9 mm	2,3 mm
TCP	44301679	Tornillo para chimeneas anguladas TCP H2	1,6 mm	7,9 mm	2,3 mm
	44301698	Tornillo para chimeneas anguladas H3-H4	1,6 mm	9,8 mm	2,3 mm
TCP	44301698	Tornillo para chimeneas anguladas TCP H3-H4	1,6 mm	9,8 mm	2,3 mm
	44302041	Tornillo para chimeneas ang. cónico 10º y 30º	2 mm	4,1 mm	2,3 mm
	44301440	Tornillo para chimeneas ang. Multiunit	1,4 mm	4 mm	2 mm



INHEX MAXI

CE 0051 Compliance according to Regulation (EU) 2017/745 verified by Notified Body

	REF.	DESCRIPCIÓN	M	L	D
	44302083	Tornillo para chimeneas anguladas	2 mm	8,3 mm	2,3 mm
TCP	44302083	Tornillo para chimeneas anguladas TCP	2 mm	8,3 mm	2,3 mm
	44302098	Tornillo para chimeneas anguladas	2mm	9,8 mm	2,3 mm
TCP	44302098	Tornillo para chimeneas anguladas TCP	2mm	9,8 mm	2,3 mm
	44302018	Tornillo para chimeneas anguladas	2mm	11,8mm	2,3 mm
TCP	44302018	Tornillo para chimeneas anguladas TCP	2mm	11,8mm	2,3 mm
	44302041	Tornillo para chimeneas ang. cónico 10º y 30º	2 mm	4,1 mm	2,3 mm
	44301440	Tornillo para chimeneas ang. Multiunit	1,4 mm	4 mm	2 mm






Correspondencia tornillos para angular interfases - interfases dinámicas

	REF. INTERFASE	CONEXIÓN	ALTURA GINGIVAL	TORNILLO	ANG. MAX.
	23237705	Inhex MINI Hexagonal	0,5mm	44301473	15º
	23237710		1mm	44301473	
	23237720		2mm	44301490	
	23237730		3mm	44301490	
	23237605	Inhex MINI Rotatorio	0,5mm	44301473	
	23237610		1mm	44301473	
	23237620		2mm	44301490	
	23237630		3mm	44301490	
	23637720	Inhex MINI Hexagonal TCP	2mm	44301490	
	23637730		3mm	44301490	
	23637620	Inhex MINI Rotatorio TCP	2mm	44301490	
	23637630		3mm	44301490	
	23207705	Inhex STD Hexagonal	0,5mm	443010151	20º
	23207710		1mm	44301679	
	23207720		2mm	44301679	
	23207730		3mm	44301698	
	23207605	Inhex STD Rotatorio	0,5mm	443010151	
	23207610		1mm	44301679	
	23207620		2mm	44301679	
	23207630		3mm	44301698	
	23607720	Inhex STD Hexagonal TCP	2mm	44301679	
	23607730		3mm	44301698	
	23607740		4mm	44301698	
	23607620	Inhex STD Rotatorio TCP	2mm	44301679	
	23607630		3mm	44301698	
	23607640		4mm	44301698	
	23257705	Inhex MAXI Hexagonal	0,5mm	44302083	20º
	23257710		1mm	44302098	
	23257720		2mm	44302098	
	23257730		3mm	44302018	
	23257605	Inhex MAXI Rotatorio	0,5mm	44302083	
	23257610		1mm	44302098	
	23257620		2mm	44302098	
	23257630		3mm	44302018	
	23657720	Inhex MAXI Hexagonal TCP	2mm	44302098	
	23657730		3mm	44302018	
	23657740		4mm	44302018	
	23657620	Inhex MAXI Rotatorio TCP	2mm	44302098	
	23657630		3mm	44302018	
	23657640		4mm	44302018	
	13237602	PC 10º Rot MINI	0,85mm	44302041	30º
	13207602	PC 10º Rot	0,4mm	44302041	
	13237652	PC 10º NoRot	0,4mm	44302041	
	13237653	PC 30º Rot	0,4mm	44302041	
	13237617	PC MUnit Rot	0,85mm	44301440	

Set de prostodoncia

154145073 Set de prostodoncia

REF.	DESCRIPCIÓN
15251125	Destornillador carraca ø 7 mm dia. hex. 1,25 l. 9 mm
15252125	Destornillador carraca ø 7 mm dia. hex. 1,25 l. 14 mm
15252525	Destornillador carraca ø 7 mm dia. hex. 1,25 l. 25 mm
15261125	Destornillador torque carraca ø 7 mm hexagonal l. 9 mm
15262125	Destornillador torque carraca ø 7 mm hexagonal l. 14 mm
15253125	Destornillador carraca ø 7 mm plano l. 14 mm
14658009	Extensor carraca ø 7 mm corto
14658016	Extensor carraca ø 7 mm largo
13801525	Destornillador para c/a hex. 1,25 l. 9 mm
13802525	Destornillador para c/a hex. 1,25 l. 14 mm
13861125	Destornillador torque para c/a hex. l. 9 mm
13862125	Destornillador torque para c/a hex. l. 14 mm
13863125	Destornillador para c/a plano l. 14 mm
23209021	Adaptador de c/a hex.
14658040	Llave de torque regulable ø 7 mm 10-40 Ncm
154040002	Caja Compact
154045072	Bandeja de prostodoncia

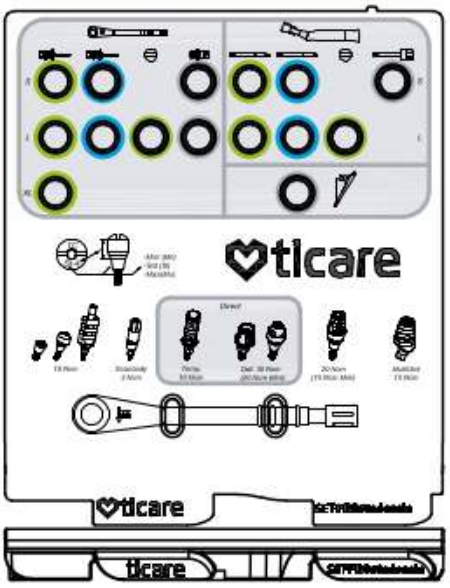



Todo el catálogo de productos está disponible en nuestra tienda online Genetic.

GENETIC ticare

ticare

Escoge tu mejor opción

COMPACT SURGICAL BOX



Compact Surgical Box Inhex + Quattro

15414534 Compact Surgical Box Inhex + Quattro

REF.	DESCRIPCIÓN	REF.	DESCRIPCIÓN
23209021	Adaptador para c/a	13102032	Perfiladora 3,3 mm Inhex
13802525	Destornillador c/a hex. largo 1,25 l. 14 mm	13102037	Perfiladora 3,75 mm Inhex
15252125	Destornillador hex. 1,25 mm manual 14 mm	13102042	Perfiladora 4,25 mm Inhex
23207001	Transportador largo 20 mm Inhex STD	13102049	Perfiladora 5,0 mm Inhex
13109034	Pin de paralelización MINI	139133326	Fresa huesos duros helicoidal RCD 3,2 mm
13109041	Pin de paralelización STD	139133356	Fresa huesos duros helicoidal RCD 3,5 mm
13109050	Pin de paralelización MAXI	139133406	Fresa huesos duros helicoidal RCD 4,0 mm
23257011	Remover largo Inhex MINI	139133496	Fresa huesos duros helicoidal RCD 4,9 mm
23257014	Remover largo Inhex STD	13114040	Fresa piloto RCD
14602000	Extensor de fresa 15 mm	13114033	Fresa perfiladora Quattro RCD 3,30 mm
132520206	Fresa inicial 2,00 RCD	13114037	Fresa perfiladora Quattro RCD 3,75 mm
139116206	Fresa 2,00 helicoidal RCD	13114042	Fresa perfiladora Quattro RCD 4,25 mm
139133306	Fresa helicoidal RCD 3,0 mm	14658010	Llave de carraca
139133336	Fresa helicoidal RCD 3,3 mm	14658009	Extensor carraca 7 mm
139133386	Fresa helicoidal RCD 3,8 mm	154045332	Bandeja Inhex + Quattro
139133436	Fresa helicoidal RCD 4,3 mm	154040002	Caja Compact
139133476	Fresa helicoidal RCD 4,7 mm		



Longitud de la fresa inicial: 13 mm
Longitud de las fresas helicoidales: 16 mm

Compact Surgical Box Inhex Osseous

154145053 Compact Surgical Box Inhex Osseous

REF.	DESCRIPCIÓN	REF.	DESCRIPCIÓN
23209021	Adaptador para c/a	139133386	Fresa helicoidal RCD 3,8 mm
13802525	Destornillador c/a hex. largo 1,25 l. 14 mm	139133436	Fresa helicoidal RCD 4,3 mm
15252125	Destornillador hex. 1,25 mm manual 14 mm	139133476	Fresa helicoidal RCD 4,7 mm
23207001	Transportador largo 20 mm Inhex STD	13102032	Perfiladora 3,25 mm Inhex
14607001	Transportador largo 20 mm Osseous STD	13102037	Perfiladora 3,75 mm Inhex
13109034	Pin de paralelización MINI	13102042	Perfiladora 4,25 mm Inhex
13109041	Pin de paralelización STD	13102049	Perfiladora 5,0 mm Inhex
13109050	Pin de paralelización MAXI	13102040	Avellanadora 3-4 mm Osseous
23257011	Remover largo Inhex STD	139133326	Fresa huesos duros helicoidal RCD 3,2 mm
23257014	Remover largo Inhex MINI	139133356	Fresa huesos duros helicoidal RCD 3,5 mm
14602000	Extensor de fresa 15 mm	139133406	Fresa huesos duros helicoidal RCD 4,0 mm
14658009	Extensor carraca 7mm corto	139133496	Fresa huesos duros helicoidal RCD 4,9 mm
132520206	Fresa inicial 2,00 RCD	14658010	Llave de carraca
139116206	Fresa 2,00 helicoidal RCD	154045032	Bandeja Osseous-Inhex
139133306	Fresa helicoidal RCD 3,0 mm	154040002	Caja Compact
139133336	Fresa helicoidal RCD 3,3 mm		



Longitud de la fresa inicial: 13 mm
Longitud de las fresas helicoidales: 16 mm

Compact Surgical Box Quattro

15414504 Compact Surgical Box Quattro

REF.	DESCRIPCIÓN	REF.	DESCRIPCIÓN
23209021	Adaptador para c/a	23257011	Remover largo Inhex MINI
15252125	Destornillador hex. 1,25 mm manual 14 mm	132520206	Fresa inicial 2,00 RCD
14658009	Extensor carraca 7 mm corto	139116206	Fresa 2,00 helicoidal RCD
14607001	Transportador largo 20 mm Osseous STD	13114040	Fresa piloto RCD
23207001	Transportador largo 20 mm Inhex STD	13114033	Fresa perfiladora Quattro RCD 3,30 mm
14602000	Extensor de fresa 15 mm	13114037	Fresa perfiladora Quattro RCD 3,75 mm
13109041	Pin de paralelización STD	13114042	Fresa perfiladora Quattro RCD 4,25 mm
23257004	Remover Inhex STD	139133306	Fresa helicoidal RCD 3,0 mm
14657004	Remover Osseous STD	139133336	Fresa helicoidal RCD 3,3 mm
13109003	Indicador de profundidad 1,7-2,5 mm Inh MINI	139133386	Fresa helicoidal RCD 3,8 mm
23257014	Remover largo Inhex STD	13102040	Avellanadora 3-4 mm Osseous
14657014	Remover largo Osseous STD	14658010	Llave de carraca



Longitud de la fresa inicial: 13 mm
Longitud de las fresas helicoidales: 16 mm

Compact Surgical Box Plus

154145053 Compact Surgical Box Plus

REF.	DESCRIPCIÓN	REF.	DESCRIPCIÓN
14607004	Transportador largo 20 mm Oss Mini c/t	139633336	Fresa 3,30 helicoidal larga l. 21 mm RCD
14607009	Transportador largo 20 mm Oss Maxi c/t	139633386	Fresa 3,80 helicoidal larga l. 21 mm RCD
23207004	Transportador largo 20 mm Inh MINI c/t	139633436	Fresa 4,30 helicoidal larga l. 21 mm RCD
23207009	Transportador largo 20 mm Inh MAXI c/t	139633476	Fresa 4,70 helicoidal larga l. 21 mm RCD
13861125	Destornillador torque para c/a hex l. 9 mm	131073406	Terraja 3,30/3,40 Oss/Inh l. 10 mm
13862125	Destornillador torque para c/a hex l. 14 mm	131073756	Terraja 3,75 Oss/Inh l. 10 mm
15251125	Destornillador carraca 7 mm hex. 1,25 l. 8 mm	131074256	Terraja 4,25 Oss/Inh l. 10 mm
13109004	Indicador de profundidad STD	131075006	Terraja 5,00 Oss/Inh l. 10 mm
14658016	Extensor carraca 7 mm dia. corto	13109034	Pin paralelización Mini
14607100	Intercambiador de transportador	13103333	Perfiladora subcrestal prótesis 3,4/3,7
139521206	Fresa helicoidal 21x2 mm larga	13105050	Perfiladora subcrestal prótesis 4,1/4,5
132020206	Fresa inicial larga l. 13 mm RCD	23209031	Adaptador de C/A hexagonal largo
139633306	Fresa 3 helicoidal larga l. 21 mm RCD		



Longitud de las fresas largas: 21 mm

ticare fresas

*CE 0051 Compliance according to Regulation (EU) 2017/745 verified by Notified Body

~CE Compliance according to Regulation (EU) 2017/745

Set bandeja de topes de fresas

REF.	DESCRIPCIÓN	REF.	DESCRIPCIÓN	REF.	DESCRIPCIÓN
154040133	**Set bandeja de topes de fresas**				
Topes de fresas A		**Topes de fresas B**		**Topes de fresas C**	
*13973306	3,3-3,4 longitud 6 mm	*13973706	3,75-4,25 longitud 6 mm	*13975006	5,0 longitud 6 mm
*13973308	3,3-3,4 longitud 8 mm	*13973708	3,75-4,25 longitud 8 mm	*13975008	5,0 longitud 8 mm
*13973309	3,3-3,4 longitud 9 mm	*13973709	3,75-4,25 longitud 9 mm	*13975009	5,0 longitud 8 mm
*13973310	3,3-3,4 longitud 10 mm	*13973710	3,75-4,25 longitud 10 mm	*13975010	5,0 longitud 10 mm
*13973311	3,3-3,4 longitud 11.5 mm	*13973711	3,75-4,25 longitud 11.5 mm	*13975011	5,0 longitud 11,5 mm
*13973313	3,3-3,4 longitud 13 mm	*13973713	3,75-4,25 longitud 13 mm	*13975013	5,0 longitud 13 mm
*13973315	3,3-3,4 longitud 15 mm	*13973715	3,75-4,25 longitud 15 mm	*13975015	5,0 longitud 15 mm
¨13973301	Clip 3,3-3,4	¨13973701	Clip 3,75-4,25	¨13975001	Clip 5,0

La bandeja también está disponible sin los topes (Ref. 154040132)




Set bandeja topes de fresa básicos

REF.	DESCRIPCIÓN
154040143	**Set bandeja topes de fresa básicos**
*13973306	Tope fresa plataforma 3.3-3.4 L=6 mm
*13973308	Tope fresa plataforma 3.3-3.4 L=8 mm
*13973309	Tope fresa plataforma 3.3-3.4 L=9 mm
*13973310	Tope fresa plataforma 3.3-3.4 L=10 mm
*13973311	Tope fresa plataforma 3.3-3.4 L=11.5 mm
¨13973301	Clip tope para fresas 3,3-3,4



Set bandeja expansores

REF.	DESCRIPCIÓN	REF.	DESCRIPCIÓN	REF.	DESCRIPCIÓN
154040123	**Set bandeja expansores**				
*132030462	Expansor 1	*1320304633	Expansor 3	*1320304643	Expansor 5
*132030463	Expansor 2	*1320304638	Expansor 4	*1320304647	Expansor 6



EXPANSOR N°1	EXPANSOR N°2	EXPANSOR N°3	EXPANSOR N°4	EXPANSOR N°5	EXPANSOR N°6
→ 8 mm:ø 2,0 mm → 6 mm:ø 1,75 mm → TIP:ø 1,0 mm	15 mm:ø 3,0 mm 13 mm:ø 2,8 mm 11,5 mm:ø 2,65 mm 10 mm:ø 2,45 mm 9 mm:ø 2,3 mm 8 mm:ø 2,2 mm 6 mm: ø 2 mm TIP: ø 1,4 mm **Para implantes de 3,30 y 3,40**	15 mm:ø 3,5 mm 13 mm:ø 3,3 mm 11,5 mm:ø 3,1 mm 10 mm:ø 2,9 mm 9 mm:ø 2,75 mm 8 mm:ø 2,6 mm 6 mm: ø 2,4 mm TIP: ø1,7 mm **Para implantes 3,75**	15 mm:ø 4,1 mm 13 mm:ø 3,9 mm 11.5 mm:ø 3,6 mm 10 mm:ø 3,4 mm 9 mm:ø 3,25 mm 8 mm:ø 3,1 mm 6 mm: ø 2,85 mm TIP: ø 2,1 mm **Para implantes 4,25**	15 mm:ø 4,5 mm 13 mm:ø 4,2 mm 11,5 mm:ø 4,0 mm 10 mm:ø 3,8 mm 9 mm:ø 3,6 mm 8 mm:ø 3,4 mm 6 mm: ø 3mm TIP: ø 2,4 mm	15 mm:ø 4,9 mm 13 mm:ø 4,6 mm 11,5 mm:ø 4,3 mm 10 mm:ø 4,1 mm 9 mm:ø 3,9 mm 8 mm:ø 3,8 mm 6 mm: ø 3,5 mm TIP: ø 2,7 mm **Para implantes 5,0**





ticare fresas

Fresero

REF.	DESCRIPCIÓN
154040152	Fresero



Fresas iniciales

CE Compliance according to Regulation (EU) 2017/745 verified by Notified Body 0051

REF.	DESCRIPCIÓN	Ø	LONGITUD
132520206	Fresa inicial corta RCD	2,0 mm	13 mm
132020206	Fresa inicial larga RCD	2,0 mm	13 mm
139116206	Fresa helicoidal 2,0 mm RCD	2,0 mm	16 mm
139521206	Fresa larga helicoidal 2,0 mm RCD	2,0 mm	21 mm



FRESAS INICIALES

- Material: Acero inoxidable con recubrimiento de carbono diamantado
- Marcas de profundidad fresa inicial: 6-8-9 mm
- Marcas de profundidad fresa 2,0 mm: 6-8-9-10-11,5-13-15 mm

Recomendaciones:
- Fresas RCD: Reemplazar después de 40 fresados de lecho de implante y sus correspondientes esterilizaciones
- Esterilizar solo aquellas fresas que se vayan a utilizar

Fresas helicoidales RCD

CE Compliance according to Regulation (EU) 2017/745 verified by Notified Body 0051

REF.	DESCRIPCIÓN	Ø	LONGITUD
139133306	Fresa helicoidal 3,0 mm RCD	3,0 mm	16 mm
139133336	Fresa helicoidal 3,3 mm RCD	3,3 mm	16 mm
139133386	Fresa helicoidal 3,8 mm RCD	3,8 mm	16 mm
139133436	Fresa helicoidal 4,3 mm RCD	4,3 mm	16 mm
139133476	Fresa helicoidal 4,7 mm RCD	4,7 mm	16 mm



FRESAS HELICOIDALES RCD

- Material: Acero inoxidable con recubrimiento de carbono diamantado
- Fresas para hueso estándar: un anillo de color indicativo del diámetro del implante
- Marcas de profundidad fresas cortas: 6-8-9-10-11,5-13 y 15 mm
- Marcas de profundidad fresa largas: 6-8-9-10-11,5-13-15-18-20 mm

Recomendaciones:
- Reemplazar después de 40 fresados de lecho de implante y sus correspondientes esterilizaciones
- Esterilizar solo aquellas fresas que se vayan a utilizar

Fresas helicoidales largas RCD

CE Compliance according to Regulation (EU) 2017/745 verified by Notified Body 0051

REF.	DESCRIPCIÓN	Ø	LONGITUD
139633306	Fresa helicoidal larga 3,0 mm RCD	3,0 mm	21 mm
139633336	Fresa helicoidal larga 3,3 mm RCD	3,3 mm	21 mm
139633386	Fresa helicoidal larga 3,8 mm RCD	3,8 mm	21 mm
139633436	Fresa helicoidal larga 4,3 mm RCD	4,3 mm	21 mm
139633476	Fresa helicoidal larga 4,7 mm RCD	4,7 mm	21 mm





Fresas helicoidales RCD hueso denso

CE 0051 Compliance according to Regulation (EU) 2017/745 verified by Notified Body

REF.	DESCRIPCIÓN	Ø	LONGITUD
139133326	Fresa helicoidal 3,2 mm RCD	3,2 mm	16 mm
139133356	Fresa helicoidal 3,5 mm RCD	3,5 mm	16 mm
139133406	Fresa helicoidal 4,0 mm RCD	4,0 mm	16 mm
139133496	Fresa helicoidal 4,9 mm RCD	4,9 mm	16 mm



FRESAS HELICOIDALES RCD

- Material: Acero inoxidable con recubrimiento de carbono diamantado
- Fresas para hueso estándar: un anillo de color indicativo del diámetro del implante
- Fresas para hueso denso: dos anillos de color indicativos del diámetro del implante
- Marcas de profundidad 6-8-9-10-11,5-13 y 15 mm

Recomendaciones:
- Reemplazar después de 40 fresados de lecho de implante y sus correspondientes esterilizaciones

Fresas perfiladoras

CE 0051 Compliance according to Regulation (EU) 2017/745 verified by Notified Body

REF.	DESCRIPCIÓN	Ø	LONGITUD
13102032	Perfiladora 3,3 mm Inhex 3,25	3,25 mm	16 mm
13102037	Perfiladora 3,75 mm Inhex 3,6	3,6 mm	16 mm
13102042	Perfiladora 4,25 mm Inhex 4,1	4,1 mm	16 mm
13102049	Perfiladora 5,0 mm Inhex 4,9	4,85 mm	16 mm



FRESAS PERFILADORAS

- Material: Acero inoxidable
- Anillo de color indicativo del diámetro del implante
- Incluyen marcas de profundidad en el vástago para realizar perfilados subcrestales.

Recomendaciones:
- Remplazar después de 20 fresados de lecho de implante y sus correspondientes esterilizaciones

Fresas perfiladoras Quattro RCD

CE 0051 Compliance according to Regulation (EU) 2017/745 verified by Notified Body

REF.	DESCRIPCIÓN	Ø	LONGITUD
13114033	Perfiladora 3,3 mm Quattro RCD	3,3 mm	16 mm
13114037	Perfiladora 3,75 mm Quattro RCD	3,7 mm	16 mm
13114042	Perfiladora 4,25 mm Quattro RCD	4,2 mm	16 mm
13114040	Fresa piloto 3,00 mm Quattro RCD	2,8 mm	



FRESAS PERFILADORAS QUATTRO RCD

- Material: Acero inoxidable con recubrimiento de carbono diamantado
- Anillo de color indicativo del diámetro del implante
- Marcas de profundidad: 1,6-8-9-10-11,5-13-15 mm

Recomendaciones:
- Remplazar después de 40 fresados de lecho de implante y sus correspondientes esterilizaciones

Terrajas

CE 0051 Compliance according to Regulation (EU) 2017/745 verified by Notified Body

REF.	DESCRIPCIÓN	Ø	LONGITUD
131073406	Terraja 3,3/3,4 mm	3,3 mm	16 mm
131073756	Terraja 3,75 mm	3,75 mm	16 mm
131074256	Terraja 4,25 mm	4,25 mm	16 mm
131075006	Terraja 5,0 mm	5 mm	16 mm
131075406	Terraja MAXI PS	5 mm	16 mm



TERRAJAS


- Material: Acero inoxidable
- Marcas de profundidad: 6-8-9-10-11,5-13-15 mm

Recomendaciones:
- Utilizar de forma manual con el extensor de carraca y la llave de carraca
- Utilizar con el contra-ángulo junto con el adaptador de contra-ángulo
- Velocidad recomendada: 15 rpm



Fresa crestal

REF.	DESCRIPCIÓN
13102150	Fresa perfiladora hueso crestal



FRESA CRESTAL

- Material: Acero inoxidable
- Para eliminar hueso presente en la plataforma del implante y en su zona circundante
- Para implantes Inhex STD y Osseous STD y MAXI PS
- Diámetro de la plataforma: 4,1 mm
- Diámetro del cuerpo 5 mm
- Presenta un fiador para un correcto guiado de la fresa
- Producto de distribución

Recomendaciones:
- Velocidad de fresado: 150-300 rpm
- Utilizar en implantes de 3,75 y 4,25

Fresa subcrestal

REF.	DESCRIPCIÓN
13103333	Perfiladora subcrestal prótesis 3,4/3,7
13105050	Perfiladora subcrestal prótesis 4,1/4,5



FRESA SUBCRESTAL

- Material: Acero inoxidable
- Para fresado subcrestal para prótesis de emergencia clásica y plataforma 4.1 mm
- Producto de distribución

Recomendaciones:
- Velocidad fresado: 150-300 rpm

Fresas de bola

	REF.	Ø	Nº DE HOJAS
[C/A]	13714127	2,7 mm	8
	13714140	4 mm	10
[P. de mano]	137141230	2,3 mm	8
	137141270	2,7 mm	8
	137141350	3,5 mm	8



FRESAS DE BOLA

- Material: Carburo de tungsteno
- Producto de distribución



Transportadores de implantes largos

CE Compliance according to Regulation (EU) 2017/745

REF.	DESCRIPCIÓN
23207004	Transportador largo Inhex MINI
23207001	Transportador largo Inhex STD
23207009	Transportador largo Inhex MAXI



TRANSPORTADORES

- Material: Titanio grado V
- Para sustituir el transportador premontado en situaciones de compromiso de espacio
- Marcas milimétricas para cirugía transgingival
- Marca más gruesa cada 3 milímetros para facilitar la lectura

Recomendaciones:
- Utilizar junto con el Intercambiador de transportador

Intercambiador de transportador

CE Compliance according to Regulation (EU) 2017/745

REF.	DESCRIPCIÓN
14607100	Intercambiador de transportador



INTERCAMBIADOR

- Material: Acero inoxidable
- Para cambiar el transportador premontado por el transportador largo cuando se prevea una limitación de espacio

Llaves quirúrgicas

REF.	DESCRIPCIÓN
14658010	Llave de carraca
14658070	Llave de carraca dinamométrica 70 Ncm desmontable
14658250	Llave de carraca desmontable dinamométrica 250 Ncm



LLAVES

- Material: Acero inoxidable
- Producto de distribución

Llave de carraca:
- Para la colocación manual del implante o para su nivelado final
- Para pauta de expansión quirúrgica mediante expansores roscados

Recomendaciones:
- Utilizar junto con el extensor de carraca

Llave de carraca dinamométrica
- Para asegurar el torque de inserción del implante

Recomendaciones:
- Utilizar junto con el extensor de carraca

Extensores de carraca

CE Compliance according to Regulation (EU) 2017/745

REF.	DESCRIPCIÓN
14658009	Extensor carraca corto
14658016	Extensor carraca largo
14659021	Adaptador de llave de carraca dinamométrica Hexagonal



EXTENSORES

Extensor de carraca
- Longitud (A): 9 mm - Longitud (B): 16 mm
- Utilizar junto con la carraca para la nivelación final del implante
- Utilizar manualmente para la colocación manual del implante
- Para sujetar el transportador al desatornillarlo en casos de poca estabilidad primaria
- Héxagono en la base indicador de la posición del hexágono del implante
- Utilizar también para dar torque a la gama multiunit recto

Multiconversor

CE Compliance according to Regulation (EU) 2017/745

REF.	DESCRIPCIÓN
18089021	Multiconversor



MULTICONVERSOR

- Material: Acero inoxidable
- Para convertir puntas de destornillador para C/A en manuales o para usar con llave dinamométrica
- Para utilizar los bisturíes para C/A de forma manual



Extensor de fresas

CE Compliance according to Regulation (EU) 2017/745

REF.	DESCRIPCIÓN
14602000	Extensor de fresas



EXTENSOR DE FRESAS


- Material: Acero inoxidable
- Para situaciones de compromiso de espacio
- No utilizar junto a la ref. 23209021 Adaptador transportador a contra-ángulo

Adaptador de transportador a contra-ángulo


CE Compliance according to Regulation (EU) 2017/745

REF.	DESCRIPCIÓN
23209021	Adaptador transportador a contra-ángulo
23209031	Adaptador de contra-ángulo largo









ADAPTADOR DE TRANSPORTADOR A CONTRA-ÁNGULO

- Material: Acero inoxidable
- Para la colocación de implantes mediante contra-ángulo
- Para dar torque a la gama multiunit recto
- El hexágono indica la posición del hexágono del implante

- **23209021**: Ø=5 mm; A=6,35 mm; L=21,35 mm
- **23209031**: Ø=5 mm; A=9,90 mm; L=34,35 mm

Indicador de profundidad

CE 0051 Compliance according to Directive 93/42/CEE and Article 120 of Regulation (EU) 2017/745

Ø	MINI	STD	MAXI
1,7 - 2,5 mm	13109003	-	-
1,8 - 3,2 mm	-	13109004	-
2,2 - 4,1 mm	-	-	13109005
2,0 mm	131090096	Angulado	



INDICADOR DE PROFUNDIDAD

- Material: Acero inoxidable
- Marcas de profundidad: 6-8-9-10-11,5-13-15 mm
- El indicador MINI puede utilizarse para cualquier diámetro de implante y después de cada una de las fresas

Pin paralelización

CE 0051 Compliance according to Directive 93/42/CEE and Article 120 of Regulation (EU) 2017/745

MINI	STD	MAXI
13109034	13109041	13109050









PIN PARALELIZACIÓN

- Material: Titanio grado V
- Para asegurar el paralelismo entre varios implantes, verificar el eje axial del implante y para saber el espacio que ocupará la plataforma del implante
- Diámetro parte central (Ø):
  MINI - 3,4 mm
  STD - 4,1 mm
  MAXI - 5,0 mm

Remover

CE 0051 Compliance according to Directive 93/42/CEE and Article 120 of Regulation (EU) 2017/745

	MINI	STD	MAXI
Corto	23257001	23257004	23257009
Largo	23257011	23257014	23257019





REMOVER

- Material: Acero inoxidable
- Para trabajar directo al implante en aquellas situaciones en que no se desee o no sea posible utilizar el transportador premontado del implante.
- Remover corto: L= 15 mm; A=8 mm
- Remover largo: L=23 mm; A=16 mm

fidelis
CIRUGÍA GUIADA

REF.	DESCRIPCIÓN
154145063	Set Fidelis Inhex



REF.	DESCRIPCIÓN	REF.	DESCRIPCIÓN
21802000	Fresa piloto TC Fidelis	21803810	Fresa 3.8x10 mm Fidelis
21002008	Fresa 2.0x10 mm Fidelis	21803811	Fresa 3.8x11,5 mm Fidelis
21002011	Fresa 2.0x11,5 mm Fidelis	21803813	Fresa 3.8x13 mm Fidelis
21002020	Fresa 2.0x13 mm Fidelis	21007002	Transportador Inhex Fidelis
21803008	Fresa 3.0x8 mm Fidelis	14607100	Intercambiador de transportador
21803010	Fresa 3.0x10 mm Fidelis	21001090	Pin Fix Fidelis
21803011	Fresa 3.0x11,5 mm Fidelis	21803006	Fresa injerto en bloque L6 mm
21803013	Fresa 3.0x13 mm Fidelis	14658009	Extensor carraca Ø7 mm corto
21803308	Fresa 3.3x8 mm Fidelis	15252125	Destornillador carraca 7 mm dia. hex. 1,25 l. 14 mm
21803310	Fresa 3.3x10 mm Fidelis	23209021	Adaptador de contraángulo hexagonal
21803311	Fresa 3.3x11,5 mm Fidelis	13802525	Destornillador para c/a hex. largo 1,25 l. 14 mm
21803313	Fresa 3.3x13 mm drill	21002040	Bisturí circular ø 7 mm hex. 1,25 l. 14 mm
21804309	Fresa crestal Fidelis	154045062	Bandeja Fidelis
21803808	Fresa 3.8x8 mm Fidelis	154040002	Caja Compact

fidelis
CIRUGÍA GUIADA

Adaptador de contra-ángulo

CE Compliance according to Regulation (EU) 2017/745

REF.	DESCRIPCIÓN
23209021	Adaptador C/A



Casquillo férula

CE 0051 Compliance according to Directive 93/42/CEE and Article 120 of Regulation (EU) 2017/745

REF.	DESCRIPCIÓN
21004004	Casquillo férula (5 unidades)



Fresa fijación y fix pin

CE 0051 Compliance according to Directive 93/42/CEE and Article 120 of Regulation (EU) 2017/745

REF.	DESCRIPCIÓN
21803006	Fresa injerto en bloque L6 mm
21001090	Fix Pin



Transportadores para cirugía guiada

CE Compliance according to Regulation (EU) 2017/745

REF.	DESCRIPCIÓN	LONGITUD
21007002	Transportador Inhex	9,0 mm



Fresas

CE 0051 Compliance according to Regulation (EU) 2017/745 verified by Notified Body

REF.	DESCRIPCIÓN
21804309	Fresa cresal Fidelis
21802000	Fresa piloto TC Fidelis
21002008	Fresa 2.0x10 mm Fidelis
21002011	Fresa 2.0x11,5 mm Fidelis
21002020	Fresa 2.0x13 mm Fidelis
21803008	Fresa 3.0x8 mm Fidelis
21803010	Fresa 3.0x10 mm Fidelis
21803011	Fresa 3.0x11,5 mm Fidelis
21803013	Fresa 3.0x13 mm Fidelis
21803308	Fresa 3.3x8 mm Fidelis
21803310	Fresa 3.3x10 mm Fidelis
21803311	Fresa 3.3x11,5 mm Fidelis
21803313	Fresa 3.3x13 mm Fidelis
21803808	Fresa 3.8x8 mm Fidelis
21803810	Fresa 3.8x10 mm Fidelis
21803811	Fresa 3.8x11,5 mm Fidelis
21803813	Fresa 3.8x13 mm Fidelis



ADAPTADOR DE CONTRA-ÁNGULO

- Material: Acero inoxidable
- Para la colocación del implante con contra-ángulo a través de férula

CASQUILLO FÉRULA

- Material: Titanio grado V
- Para colocar en férula quirúrgica
- Permiten el fresado y la colocación guiada de los implantes

FRESA FIJACIÓN Y FIX PIN

- Material Acero inoxidable
- Para la fijación de la férula en su posición

TRANSPORTADORES

- Material: Titanio grado V
- Para la instalación de los implantes a través de la férula
- Es necesario sustituir el trasportador premontado del implante por el transportador de cirugía guiada

FRESAS

- Material: Acero inoxidable con recubrimiento de carbono diamantado
- Para implantes de 8 a 13 mm de longitud

Recomendaciones:
- Remplazar después de 40 fresados de lecho de implantes y sus correspondientes esterilizaciones

fidelis
CIRUGÍA GUIADA

Set Fidelis Plus

154145083 Set Fidelis Plus

REF.	DESCRIPCIÓN
23804033	Fresa perfiladora Quattro Fidelis TC 3,3
23804037	Fresa perfiladora Quattro Fidelis TC 3,75
23804042	Fresa perfiladora Quattro Fidelis TC 4,25
21803208	Fresa 3.2x8 mm TC Fidelis
21803508	Fresa 3.5x8 mm TC Fidelis
21804008	Fresa 4.0x8 mm TC Fidelis
21803210	Fresa 3.2x10 mm TC Fidelis
21803510	Fresa 3.5x10 mm TC Fidelis
21804010	Fresa 4.0x10 mm TC Fidelis
21803211	Fresa 3.2x11.5 mm TC Fidelis
21803511	Fresa 3.5x11.5 mm TC Fidelis
21804011	Fresa 4.0x11.5 mm TC Fidelis
21803213	Fresa 3.2x13 mm TC Fidelis
21803513	Fresa 3.5x13 mm TC Fidelis
21804013	Fresa 4.0x13 mm TC Fidelis
154040002	Compact Surgical Container Box
154045082	Bandeja Fidelis Plus



Este set es un complemento al Set Fidelis. Incorpora Fresas Perfiladoras Quattro y Fresas para Huesos Duros.

Fresas y perfiladoras Fidelis Plus

CE 0051 Compliance according to Regulation (EU) 2017/745 verified by Notified Body

REF.	DESCRIPCIÓN
23804033	Fresa perfiladora Quattro Fidelis TC 3,3
23804037	Fresa perfiladora Quattro Fidelis TC 3,75
23804042	Fresa perfiladora Quattro Fidelis TC 4,25
21803208	Fresa 3.2x8 mm TC Fidelis
21803508	Fresa 3.5x8 mm TC Fidelis
21804008	Fresa 4.0x8 mm TC Fidelis
21803210	Fresa 3.2x10 mm TC Fidelis
21803510	Fresa 3.5x10 mm TC Fidelis
21804010	Fresa 4.0x10 mm TC Fidelis
21803211	Fresa 3.2x11.5 mm TC Fidelis
21803511	Fresa 3.5x11.5 mm TC Fidelis
21804011	Fresa 4.0x11.5 mm TC Fidelis
21803213	Fresa 3.2x13 mm TC Fidelis
21803513	Fresa 3.5x13 mm TC Fidelis
21804013	Fresa 4.0x13 mm TC Fidelis



FRESAS Y PERFILADORAS

- Material: Acero inoxidable
- Para implantes de 8 a 13 mm de longitud


Recomendaciones:
- Remplazar después de 40 fresados de lecho de implante/usos y sus correspondientes esterilizaciones

- Las fresas Perfiladoras Quattro se recomiendan en hueso tipo III y IV.

- Las fresas para huesos duros permiten expandir la funcionalidad de la cirugía guiada hasta huesos de tipo I.

SET-EXplantación

atraumática y extracción de tornillos rotos

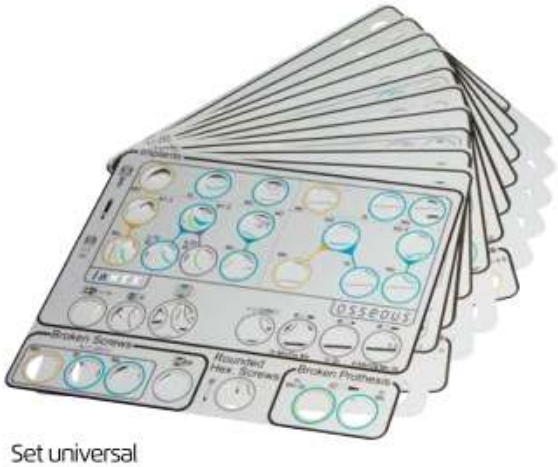

Set universal

Plantillas compatibles con otras marcas



154145043 Set de Explantación

REF.	DESCRIPCIÓN
23257011	Remover largo Inhex Mini
23257014	Remover largo Inhex Std
23257019	Remover largo Inhex Maxi
14657011	Remover largo Osseous Mini
14657014	Remover largo Osseous Std
14657019	Remover largo Osseous Maxi
14412335	Tornillo de explantación Inhex Mini
14412375	Tornillo de explantación Inhex Std
14412355	Tornillo de explantación Inhex Maxi
14411375	Tornillo de explantación Osseous Mini-Osseous Std
14411505	Tornillo de explantación Osseous Maxi
14412330	Llave de explantación Inhex Mini
14412370	Llave de explantación Inhex Std 3,75
14412420	Llave de explantación Inhex Std 4,25
14412500	Llave de explantación Inhex Maxi 5
14411330	Llave de explantación Osseous Mini
14411370	Llave de explantación Osseous Std

REF.	DESCRIPCIÓN
14411500	Llave de explantación Osseous Maxi
15252125	Destornillador carraca Ø7mm hexagonal 1,25 L14 mm
14658009	Extensor carraca Ø7mm corto
14419130	Llave de apriete de tornillo de explantación
14419032	Llave de contra-rosca Osseous Maxi-Inhex Mini
14419033	Llave de contra-rosca Inhex Std
14419031	Llave de contra-rosca Osseous Mini/Std -Inhex Maxi
14401416	Escariador extracción torn. fracturados Inhex Mini
14401417	Escariador extracción torn. fract. Oss Mini/Std Inhex Std
14401418	Escariador extracción torn. fract. Oss Maxi-Inhex Maxi
18089021	Multiconversor
14419050	Llave extracción tornillos con hexágono redondeado
14419041	Llave extracción prótesis fracturada InHex Mini/Std
14419042	Llave extracción prótesis fracturada InHex Maxi
14658250	LLave carraca desmontable dinamométrica 250 Ncm
154045042	Bandeja Set de Explantación
154040002	Caja Compact

ANEXO

Guía de torques

		MINI	STD	MAXI
Tornillos de cierre		10 Ncm	10 Ncm	10 Ncm
Tornillos de cicatrización		10 Ncm	10 Ncm	10 Ncm
Postes de impresión		10 Ncm	10 Ncm	10 Ncm
Scanbodies		3 Ncm	3 Ncm	3 Ncm
Pilares personalizados		20 Ncm	30 Ncm	30 Ncm
Pilares definitivos directos a implante		20 Ncm	30 Ncm	30 Ncm
Prótesis sobre pilar cónico 10° o 30°		15 Ncm	20 Ncm	20 Ncm
Prótesis sobre pilares de 20° multiunit rectos o angulados			15 Ncm	15 Ncm
Prótesis provisional		10 Ncm	10 Ncm	10 Ncm
Tornillos para chimeneas anguladas		Utilizar el torque recomendado por cada fabricante para el caso equivalente de chimeneas rectas.		

ANEXO

Marcas de fresa y perfiladora





GENETIC
ticare

ENTRÉGALE SU IMPLANT CARD

TRANSMITE A TU PACIENTE LA CALIDAD DEL SISTEMA TICARE

DESCARGA SU CERTIFICADO

A El DNI de su implante



ID Number
Código único Genetic para cada implante

B **Certificado** individualizado de fabricación y verificación accesible para la clínica y el paciente

El certificado se descarga vía web



Certificado de prótesis disponible al vincular en Genetic con el ID Number

Condiciones Generales*

Realización de pedidos

- Teléfono de pedidos:
  Desde España: 983 309 602
- Teléfono internacional: +34 983 211 312
- E-mail: atencionalcliente@ticareimplants.com
- Catálogo on-line: www.ticareimplants.com

Realización de pedidos

A todos los pedidos inferiores a 325 €, se les incluirá gastos de envío o irán a portes debidos.
En los pedidos realizados por **genetic.ticareimplants.com** los portes son gratuítos.

Comprobación de pedidos

Una vez recibido su pedido, compruebe que es correcto y se halla en buen estado.
Si no fuera así, póngase en contacto con nosotros lo antes posible para reponer el material que sea necesario. En caso contrario, no nos hacemos responsables del mismo.

Cambios y Devoluciones

No se admitirán cambios ni devoluciones transcurridos 75 días desde la fecha de emisión del albarán o cuando el material haya sido abierto o utilizado o su embalaje no se encuentre en perfectas condiciones.

Garantía

Consulte condiciones en www.ticareimplants.com

*Condiciones aplicables solo en España. Consultar para otros países.

MOZO-GRAU S.A. se reserva el derecho de modificar las presentes condiciones.

ticare Ticare es una marca registrada de MOZO-GRAU S.A.

RETRATAMIENTOS

ZERO

NO DEJES QUE LA PERIIMPLANTITIS REDUZCA TUS BENEFICIOS



24% incidencia periimplantitis en paciente

Entre 300€/500€ sobrecoste de materiales

Coste oportunidad: **≥1** hora de tratamiento

Coste hora/sillón periimplantitis: **600€**

-13% pérdida de beneficio

Disminución satisfacción paciente = menos ★★★★☆ valoración a la clínica



39,5% pacientes presentan complicaciones en el seguimiento a 10 años.

1,3 citas adicionales por aflojamientos de tornillos

Descarga el informe aquí.

GAP ZERO® TECHNOLOGY

ticare

inHEX

SOLO TICARE ES GAPZERO®



GAP ZERO® TECHNOLOGY ticare

Disminuye el riesgo de periimplantitis

Reduce los micromovimientos

Espira de doble rosca
Reduce tiempo de inserción y calentamiento óseo

Superficie RBM-TC
Para mayor contacto hueso-implante

Estabilidad primaria y secundaria
Y facilidad de inserción gracias a su forma anatómica

Ápice más eficaz
Cono más apuntado que aporta estabilidad primaria adicional

ticare

Tu futuro profesional empieza aquí
¿Te unes?

NextGen by ticare

En Ticare llevamos más de 30 años cuidando la salud periimplantaria y comprometidos con la ciencia, la investigación y la innovación.

Desarrollamos soluciones que garantizan la máxima seguridad y confianza en cada tratamiento.



Colaboraciones: USC · Universitat de Barcelona · ulc barcelona · Universidad de Murcia

IMQ CERTIFIED
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
ISO 13485:2016

FDA

ticare
MOVING FOR CARE

España
Teléfono: 983 309 602
Email: info@ticareimplants.com

MOZOGRAU S.A.
C/ Santiago lópez González, 7 · 47197 · Valladolid, España

www.ticareimplants.com

AC0543 20082026